




Rapport chirurgical

Détails de la commande

VALIDÉ(E)

Nom du patient: Laurence Leblond
Référence de commande client: 62721_20240410_1014_54
Date de création: 10/04/2024 10:53:22
Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)


Mandibule



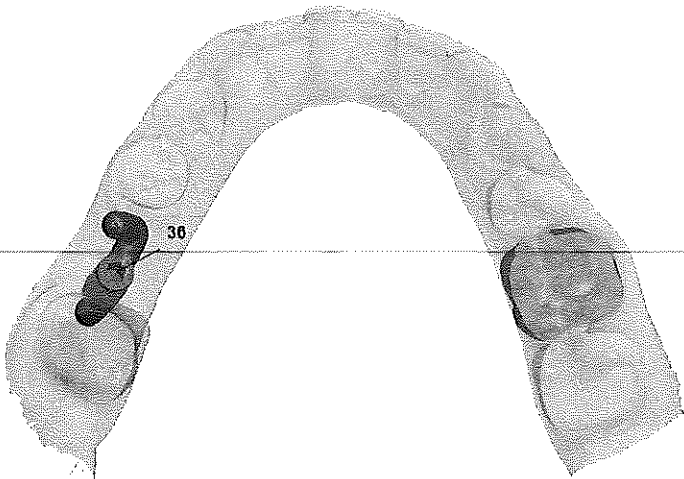


Informations sur l'implant		
Position de l'implant (FDI)	36	
Fabricant	TBR Dental	
Type	M411	
Numéro de la commande	M411	
Longueur, mm	11,5	
Diamètre (Ø), mm	3,9	
Couleur	Pink	

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.









Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	36	
Fabricant	TBR Dental	
Type	M411	
Numéro de la commande	M411	
Longueur, mm	11,5	
Diamètre (Ø), mm	3,9	
Couleur	Pink	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

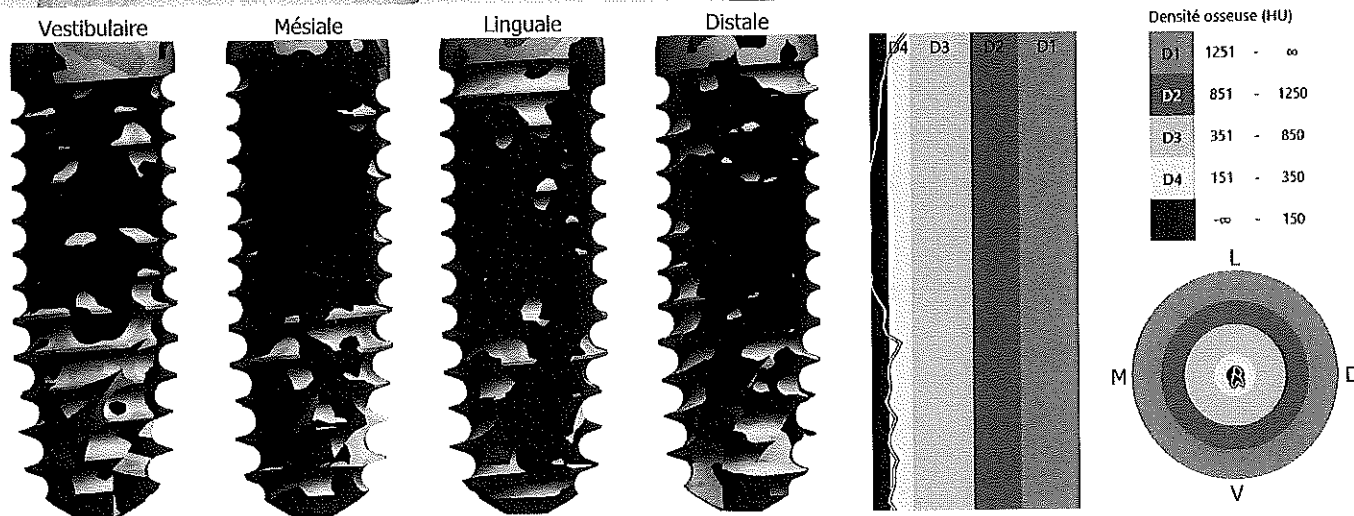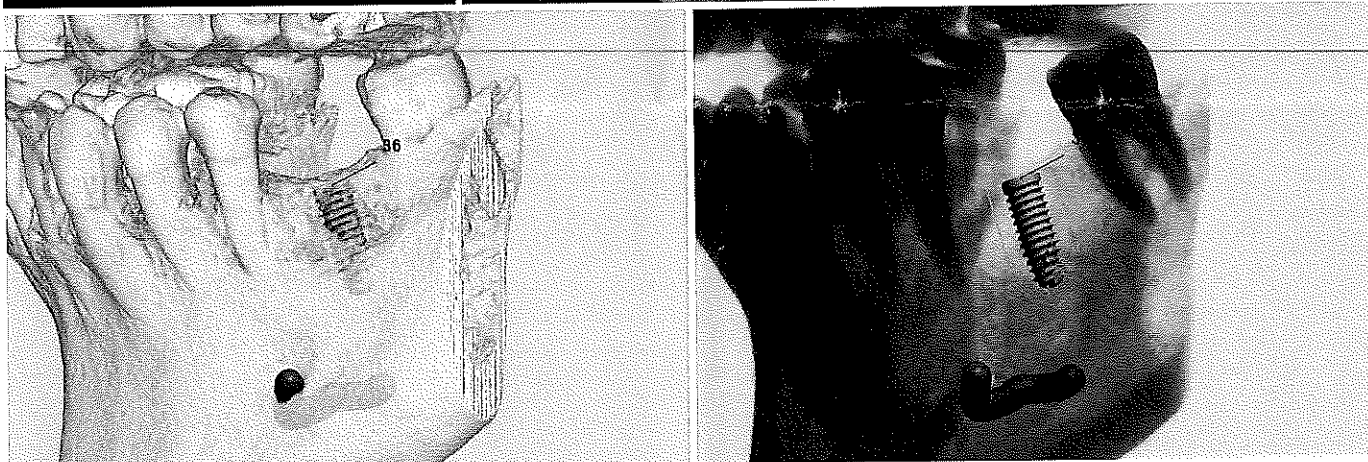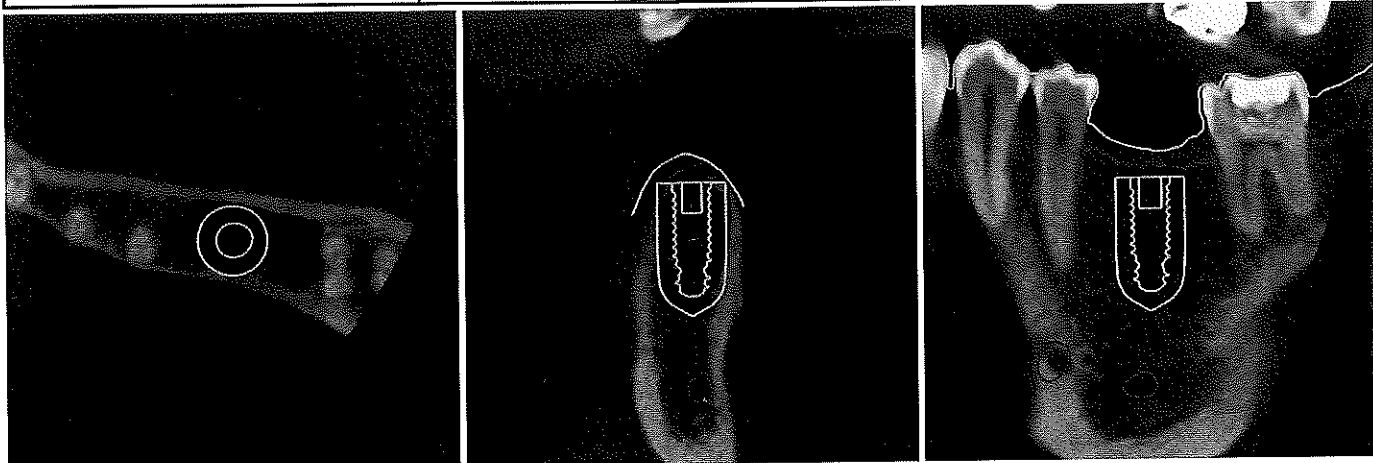

Limitation de responsabilité :


Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	36	
Fabricant	TBR Dental	
Type	M411	
Numéro de la commande	M411	
Longueur, mm	11,5	
Diamètre (Ø), mm	3,9	
Couleur	Pink	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

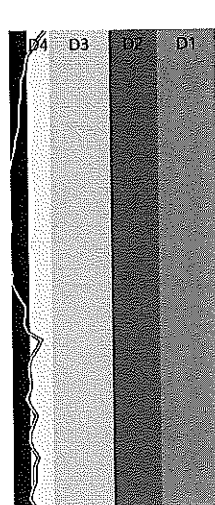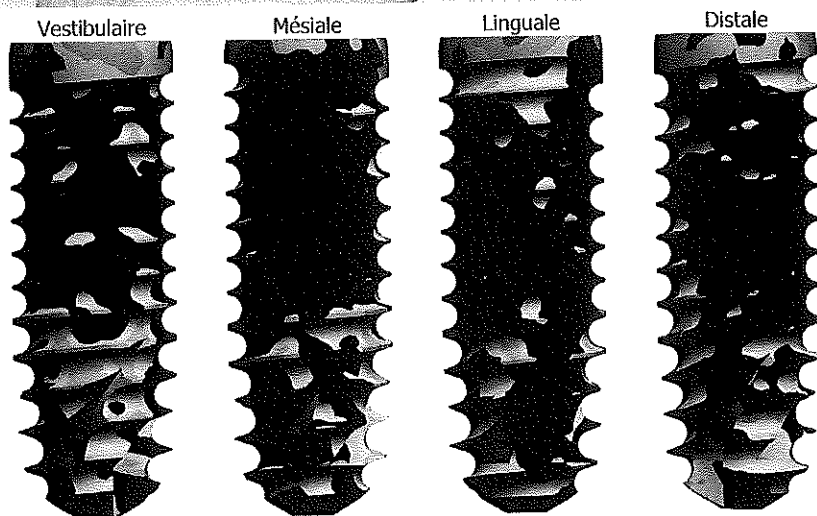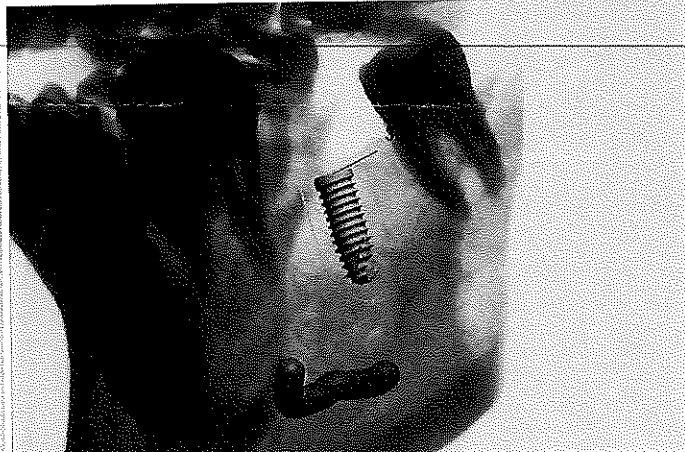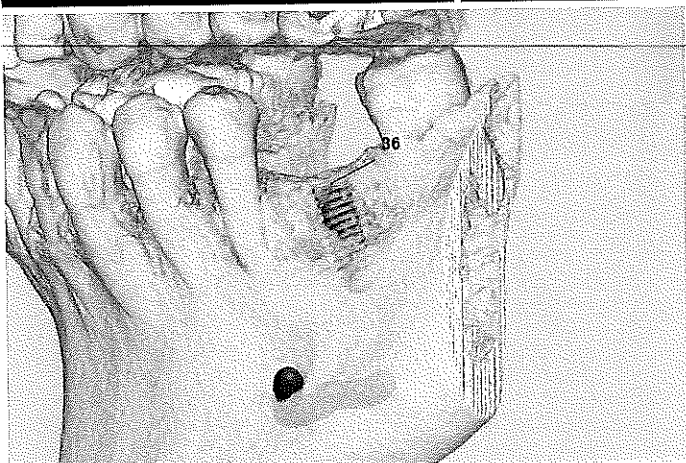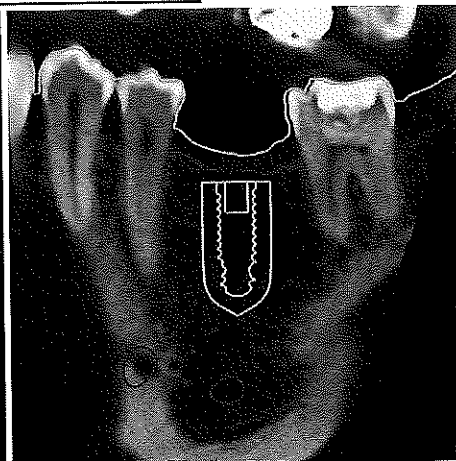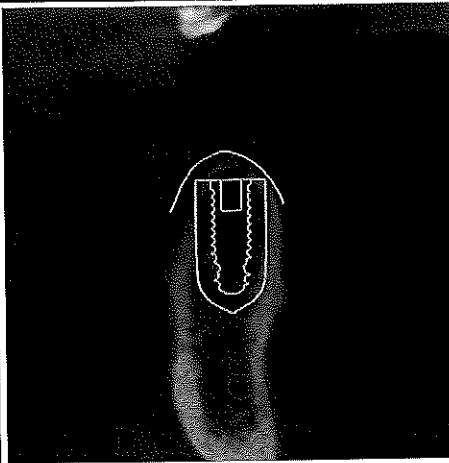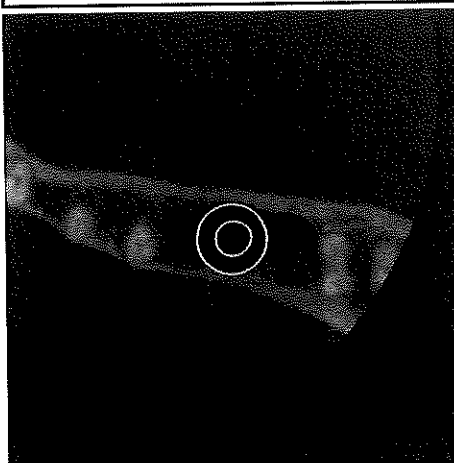

Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

données:

3Shape Implant Studio

Rapport chirurgical




Détails de la commande

Nom du patient: Laurence Leblond
Référence de commande client: 62721_20240410_1014_54
Date de création: 10/04/2024 10:53:22
Créé(e) par: Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

**POUR
VALIDATION**

Validé(e) par

Mandibule

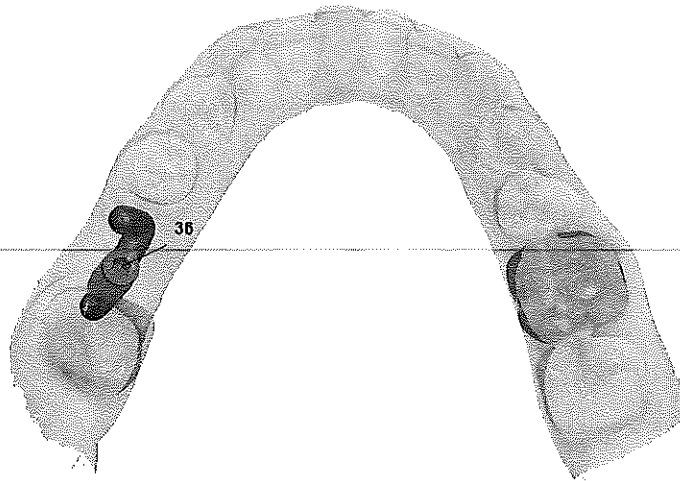

Informations sur l'implant

Position de l'implant (FDI)	36
Fabricant	TBR Dental
Type	M411
Numéro de la commande	M411
Longueur, mm	11,5
Diamètre (Ø), mm	3,9
Couleur	Pink

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.