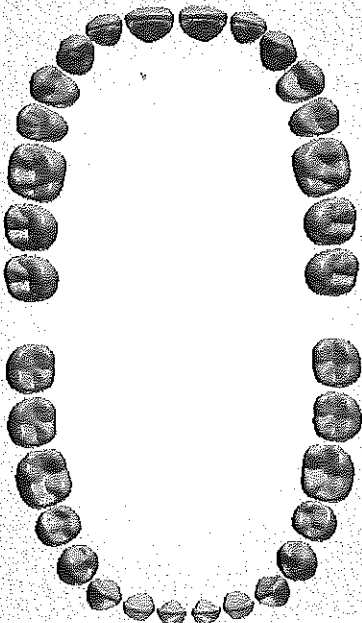


		60001_20240618_1039_Isabelle		
Types de prothèses		Informations		
		Client:	350186346	
		Contact:		
		Patient:	Martens Isabelle	
		Importance:	Normale	
		Date de création:	18/06/2024 10:39	
		Date d'expédition:	18/06/2024 10:39	
		Date de livraison:	20/06/2024 00:00	
		Date d'impression:	18/06/2024 10:46	
		Utilisateur:		
		Type d'objet:	Empreinte numérique	
Photo clinique:	Oui			
		Poste / Technicien	Approuvé(e) par	
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only
Commentaires				
guide chir 24 26				

24 : 3,5 x 10

26 = 4,5 x 8,5 [△] MD

+ 8ms

↑
4,4 mm

3Shape Implant Studio

Rapport chirurgical



Détails de la commande

VALIDÉ(E)


Nom du patient: ISABELLE MARTENS

Référence de commande client: 62721_20240618_1040_29

Date de création: 18/06/2024 15:04:03

Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Maxillaire

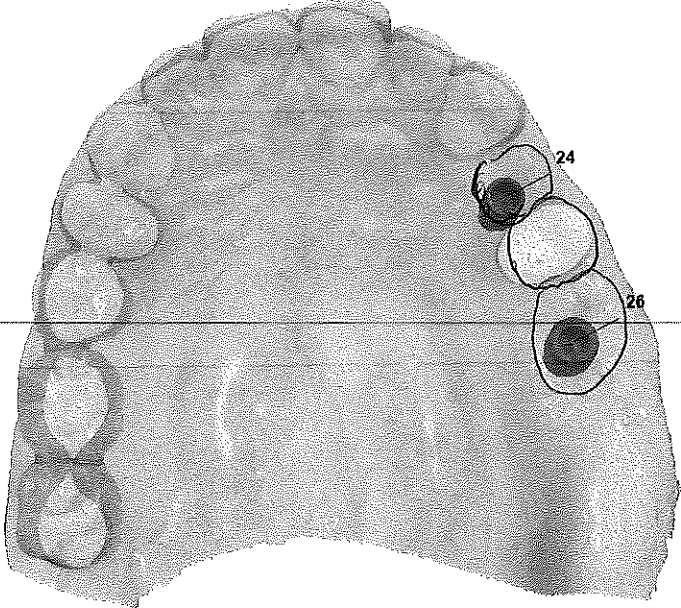






Informations sur l'implant		
Position de l'implant (FDI)	24	26
Fabricant	Global D	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L10.0 mm	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK3.5L10.0	DPINK4.5L8.5
Longueur, mm	10	8,5
Diamètre (Ø), mm	3,5	4,5
Couleur	Green	Purple

AWD

4,42 mm


SPANS


Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	24	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK3.5L10.0	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	3,5	
Couleur	Green	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

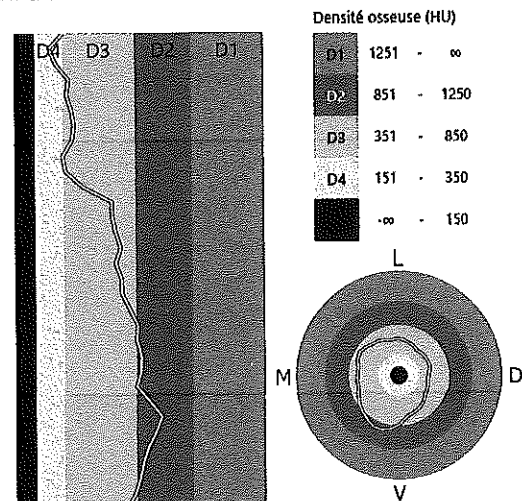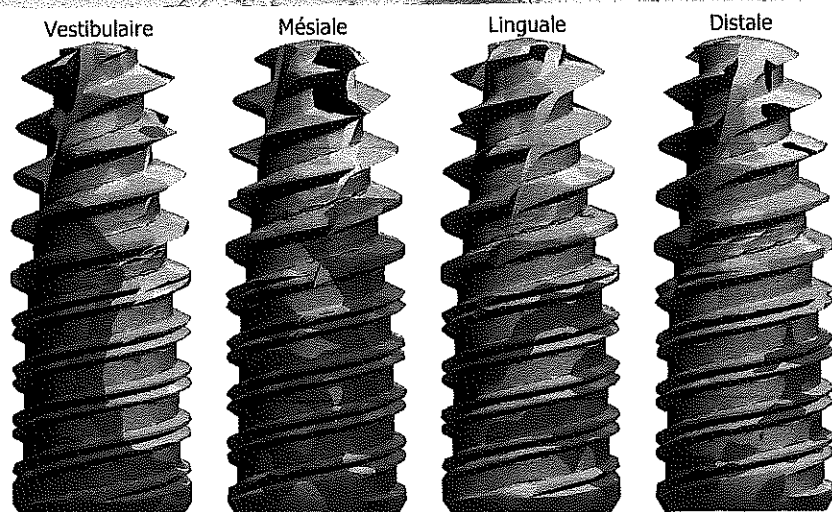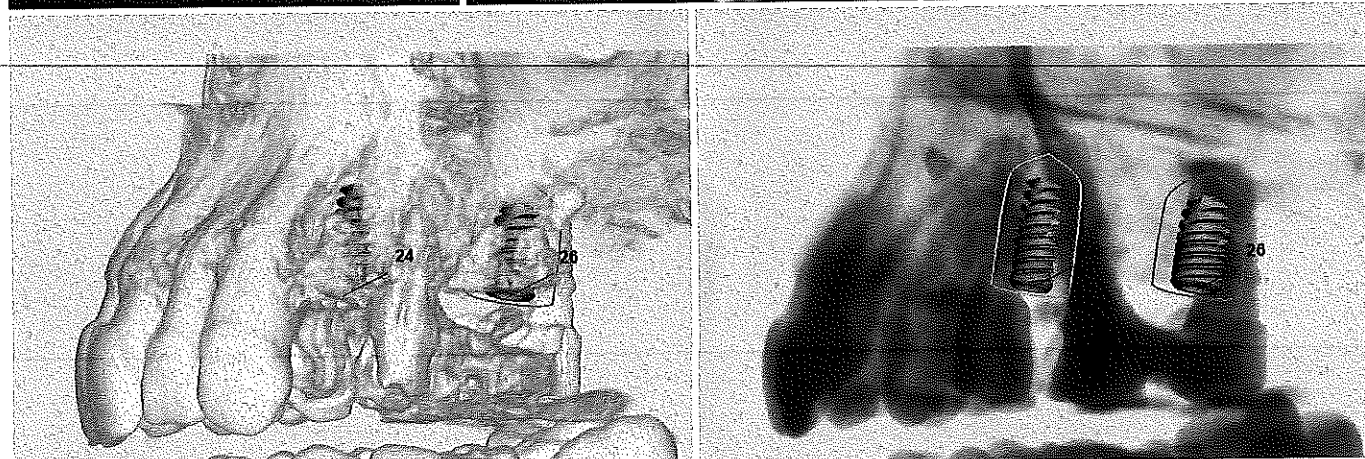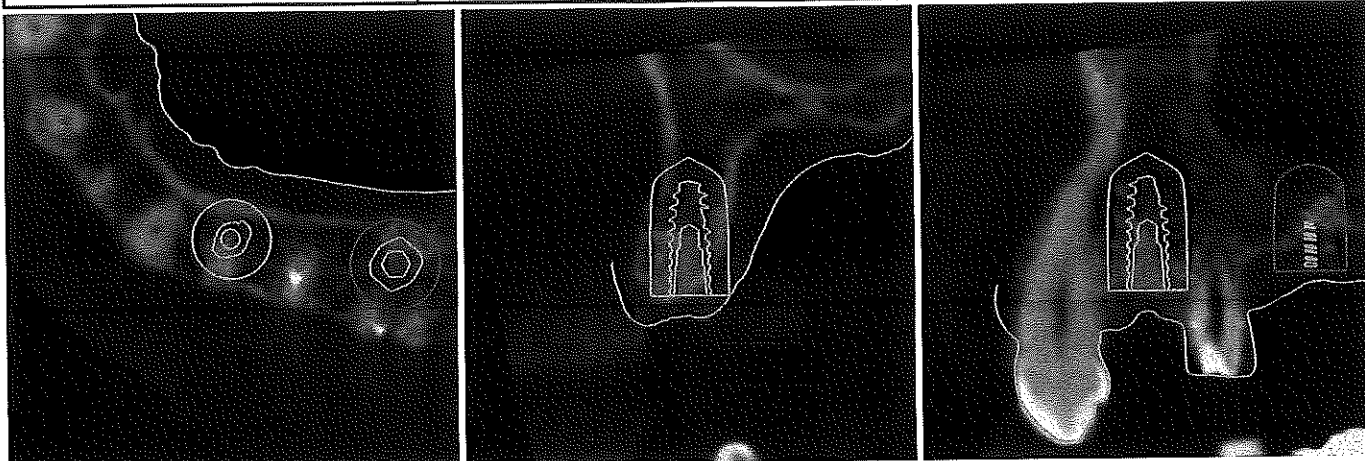

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	26	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Purple	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

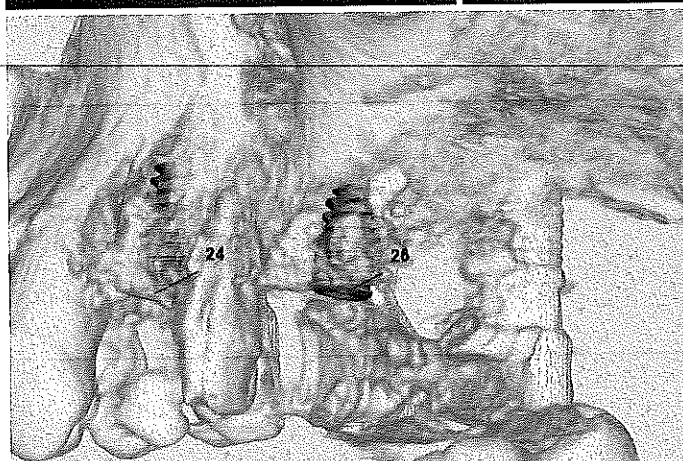


Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale

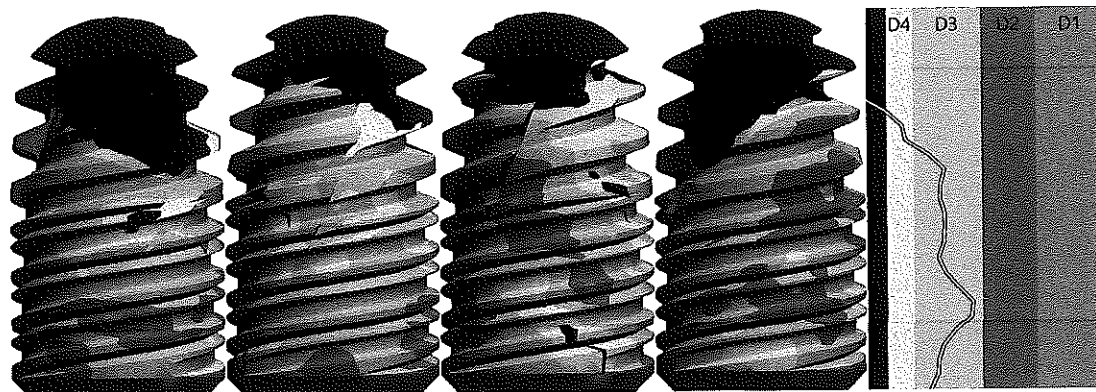

Densité osseuse (HU)

D1	1251	- ∞
D2	851	- 1250
D3	351	- 850
D4	151	- 350
	-∞	- 150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

3Shape Implant Studio

Rapport chirurgical



Détails de la commande

Nom du patient:

ISABELLE MARTENS

Référence de commande client:

62721_20240618_1040_29

Date de création:

18/06/2024 15:04:03


Créé(e) par:

Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

POUR
VALIDATION






Validé(e) par

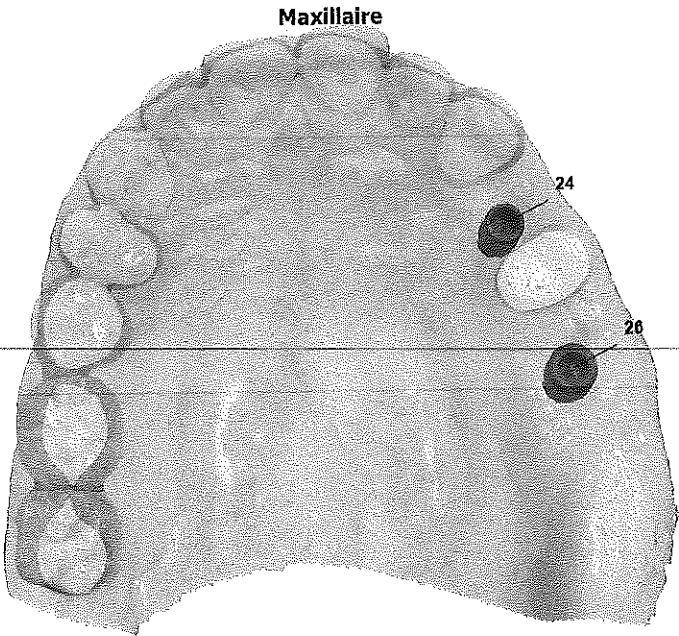




Informations sur l'implant		
Position de l'implant (FDI)	24	26
Fabricant	Global D	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L10.0 mm	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK3.5L10.0	DPINK4.5L8.5
Longueur, mm	10	8,5
Diamètre (Ø), mm	3,5	4,5
Couleur	Green	Purple

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	24	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK3.5L10.0	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	3,5	
Couleur	Green	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

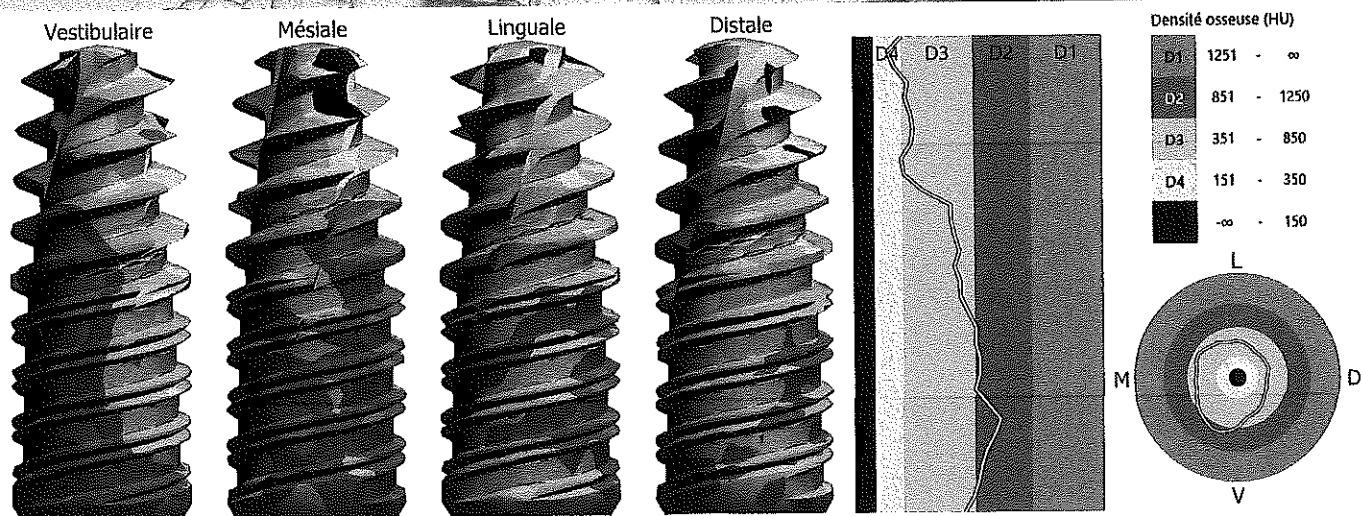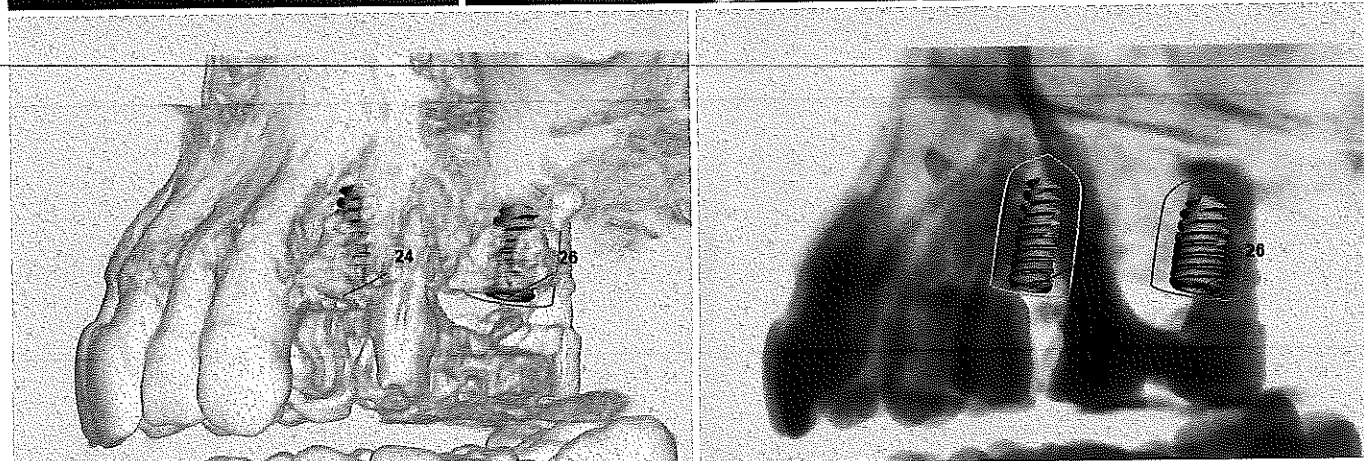

Limitation de responsabilité :
 Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	26	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Purple	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

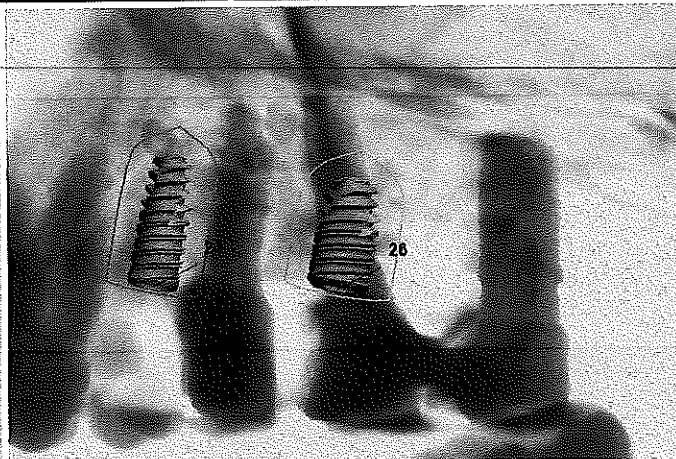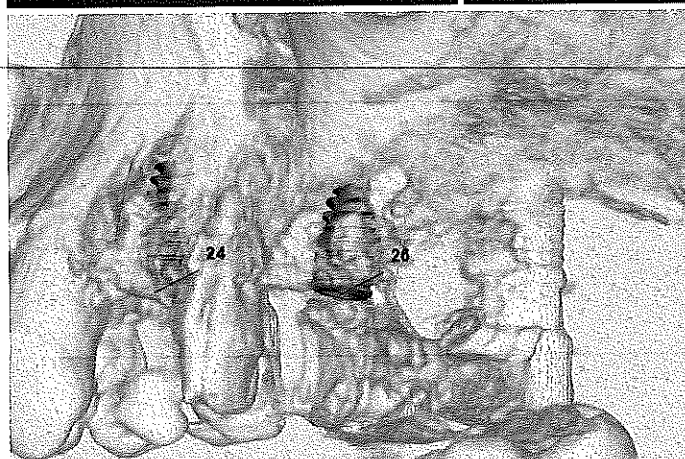

Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale



Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.