


		60001_20240621_1021_FESQUET		
Types de prothèses		Informations		
		Client:	670629594	
		Contact:		
		Patient:	Jean Pierre FESQUET	
		Importance:	Normale	
		Date de création:	21/06/2024 10:21	
		Date d'expédition:	21/06/2024 10:21	
		Date de livraison:	25/06/2024 00:00	
		Date d'impression:	26/06/2024 09:55	
		Utilisateur:		
		Type d'objet:	Empreinte numérique	
		Photo clinique:	Oui	
		Poste / Technicien	Approuvé(e) par	
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only
Commentaires				
'LOLO ELSA GUIDE CHIR 46 POUR IMPLANT GLOBAL D '				

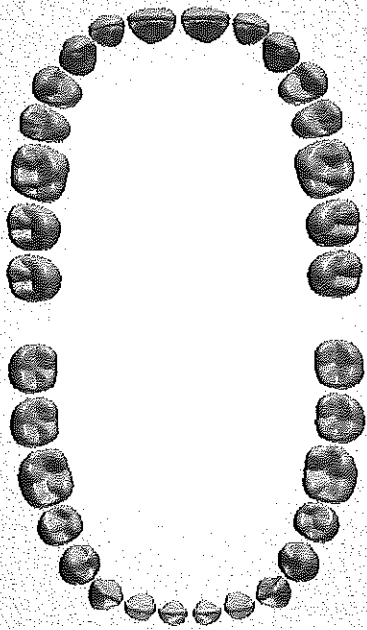

Rapport chirurgical

Détails de la commande

VALIDÉ(E)


Nom du patient: J.p Fesquet

Référence de commande client: 62721_20240702_1421_31

Date de création: 02/07/2024 14:31:46

Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)


Mandibule


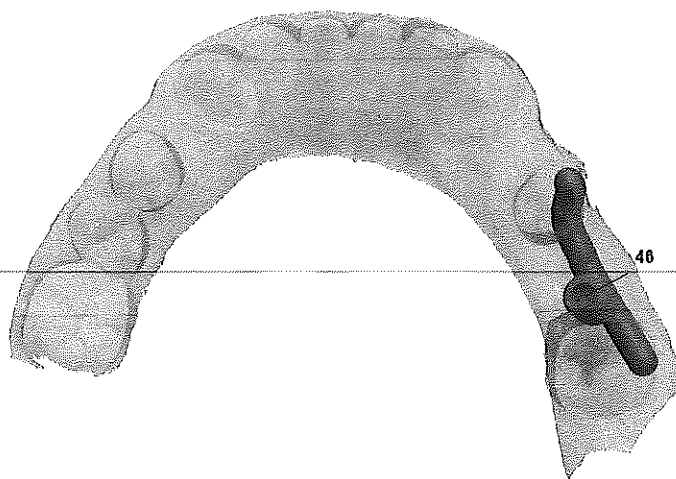


Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	46
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5
Longueur, mm	8,5
Diamètre (Ø), mm	4,5
Couleur	Purple

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	46	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Purple	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

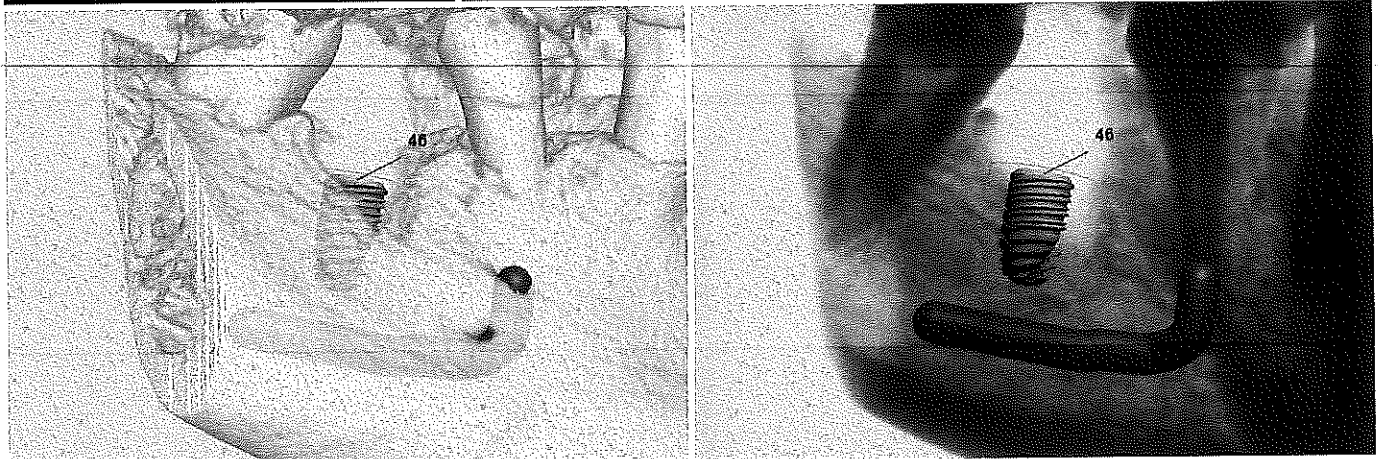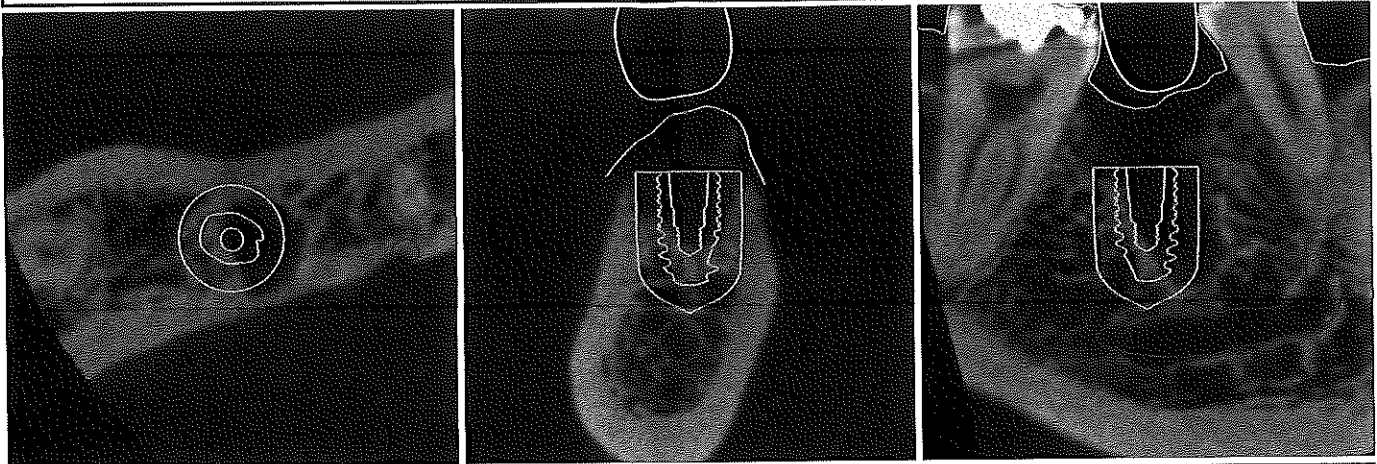


Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale

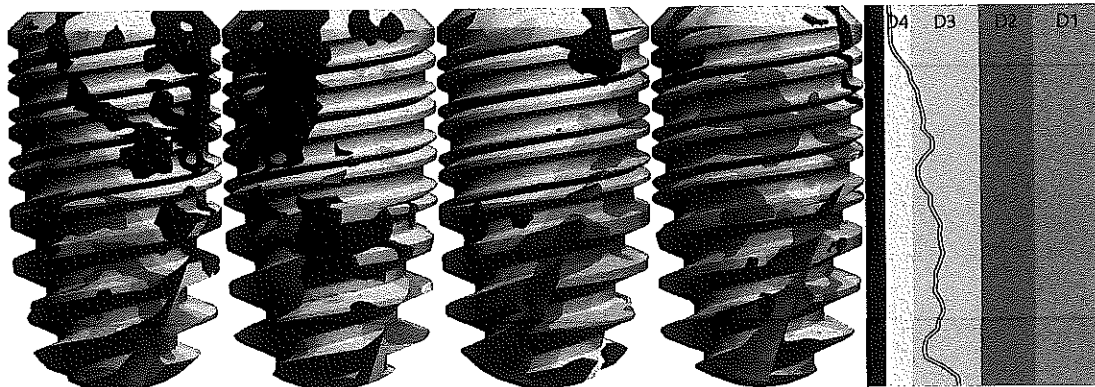

Densité osseuse (HU)

D1	1251	- ∞
D2	851	- 1250
D3	351	- 850
D4	151	- 350
	-∞	- 150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.