


		60001_20240716_1209_JOSIANE		01/108
Types de prothèses		Informations		
		Client: 350186346		
		Contact:		
		Patient: PIRELLO JOSIANE		
		Importance: Normale		
		Date de création: 16/07/2024 12:09		
		Date d'expédition: 16/07/2024 12:09		
		Date de livraison: 18/07/2024 00:00		
		Date d'impression: 16/07/2024 14:03		
		Utilisateur:		
		Type d'objet: Empreinte numérique		
		Photo clinique: Oui		
		Poste / Technicien		Approuvé(e) par
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only
Commentaires				
GUIFE CHIR 36				

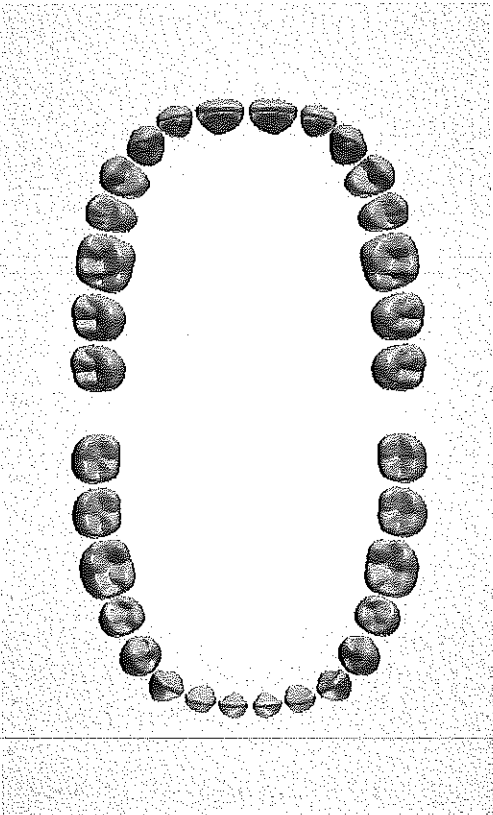

Rapport chirurgical

Détails de la commande

Nom du patient:

Josiane Pirello

Référence de commande client:

62721_20240716_1405_36

Date de création:


16/07/2024 15:41:52

Validé(e) par

Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)









VALIDÉ(E)

Mandibule

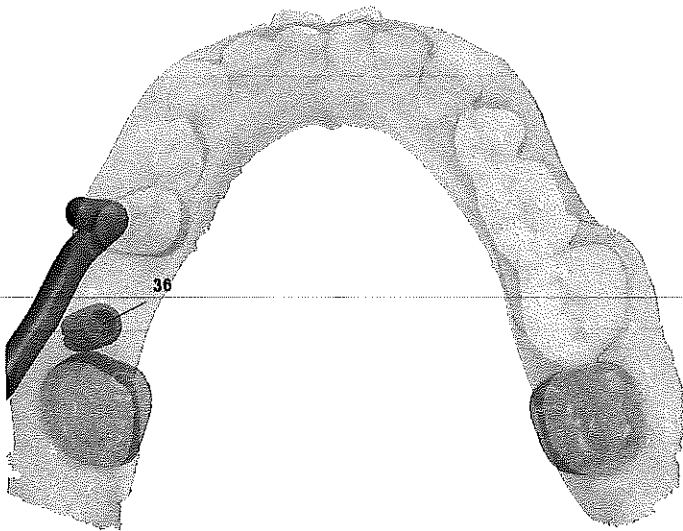

Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	36
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L10.0 mm
Numéro de la commande	DPINK4.0L10
Longueur, mm	10
Diamètre (Ø), mm	4
Couleur	Yellow

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	36	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L10	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

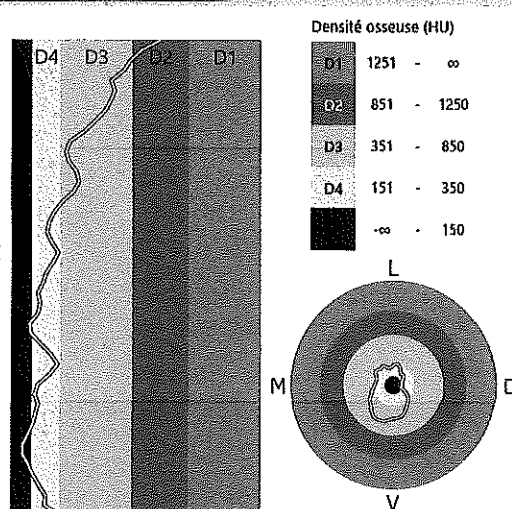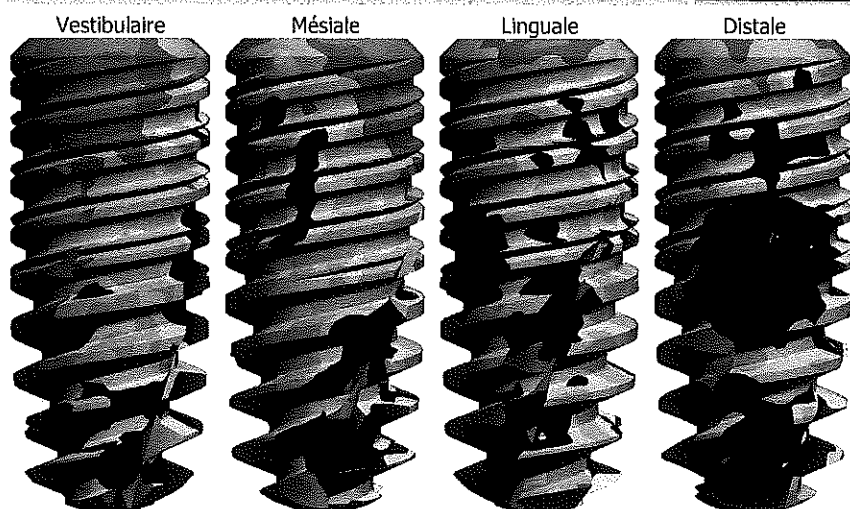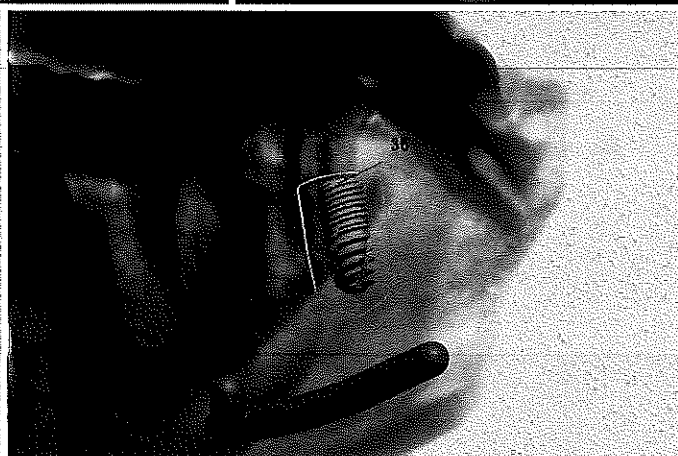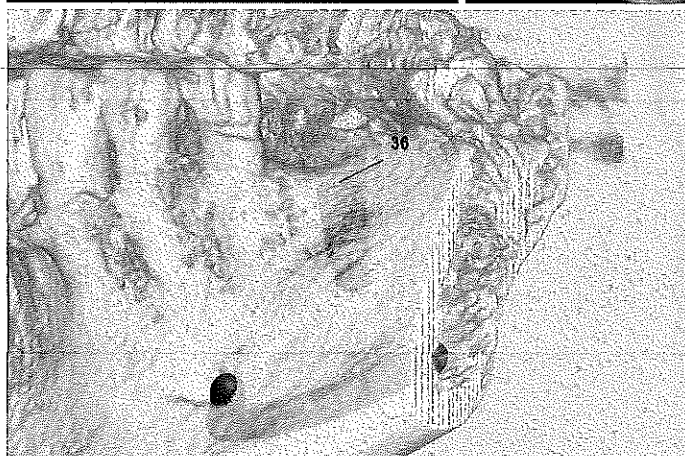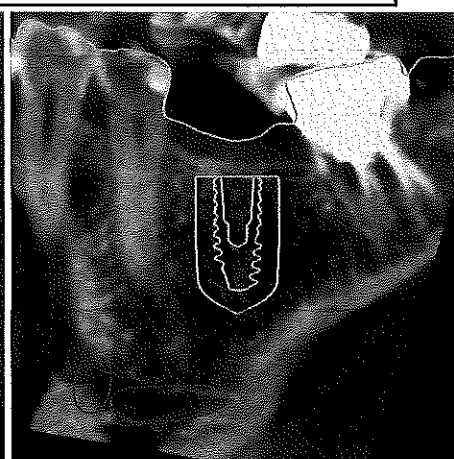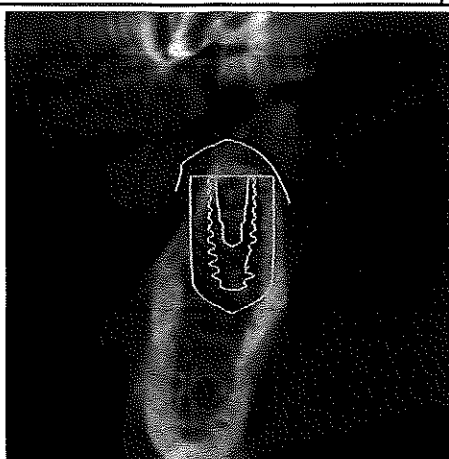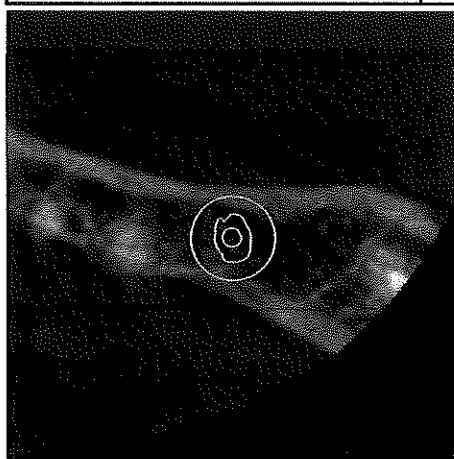

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.