




60001_20240612_1608_Jean_Paul

Types de prothèses

Informations

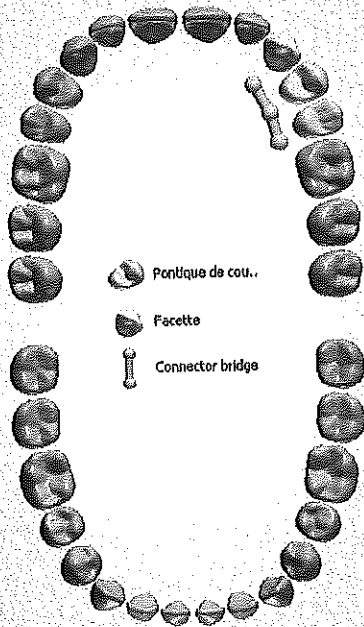

Client: 670629594
 Contact:
 Patient: Lovarco Jean Paul
 Importance: Normale
 Date de création: 12/06/2024 16:08
 Date d'expédition: 12/06/2024 16:08
 Date de livraison: 14/06/2024 00:00
 Date d'impression: 18/06/2024 10:23
 Utilisateur:
 Type d'objet: Empreinte numérique
 Photo clinique: Oui

Poste / Technicien

Approuvé(e) par

Élément

Dent

Matériau

Couleur

Fabricant

Bridge anatomique

23-25

CoCr

-

Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only

Modèle non fractionné

"Model Material"

-

Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only

Commentaires

25

Summary : AD/100 = 6,5



Rapport chirurgical

VALIDÉ(E)

Détails de la commande


Nom du patient: JEAN PAUL LOVARCO

Référence de commande client: 62721_20240618_1031_04

Date de création: 18/06/2024 15:30:39



Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Maxillaire

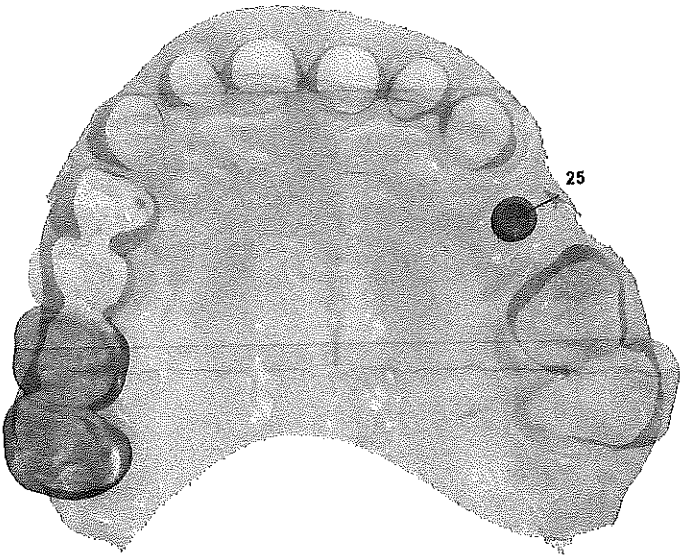

Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	25
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5
Longueur, mm	8,5
Diamètre (Ø), mm	4
Couleur	Yellow

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	25	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

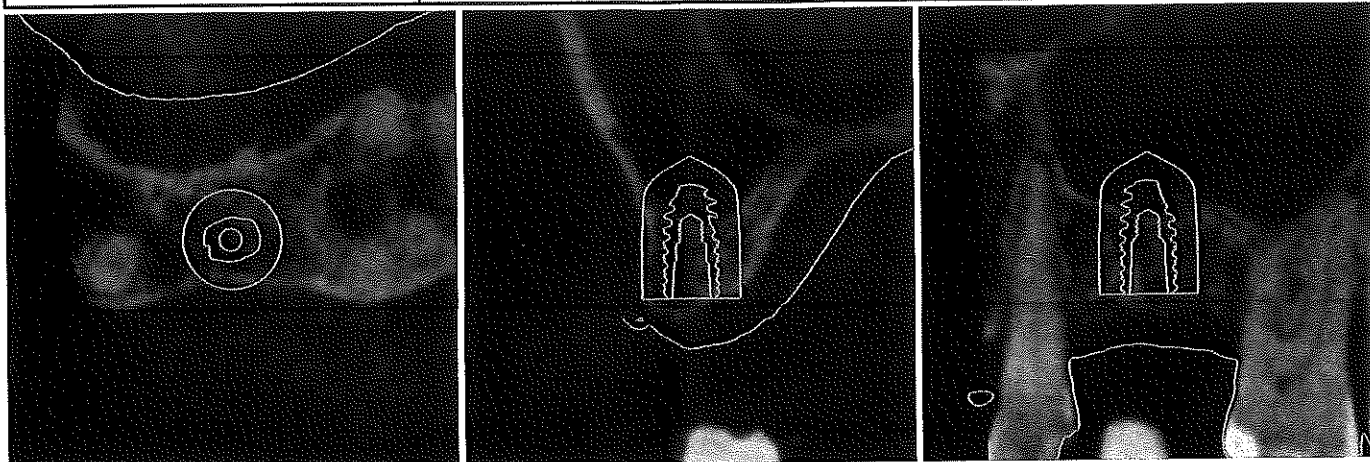


Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale

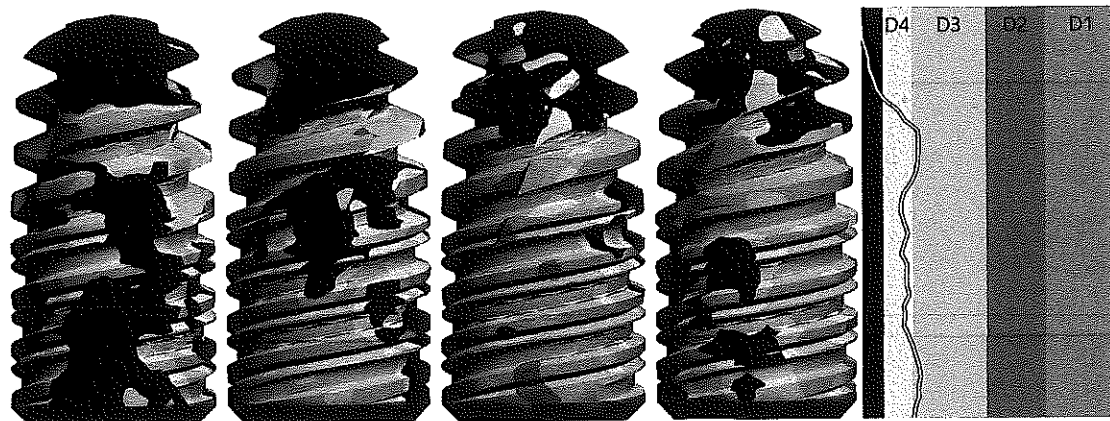

Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.