


		60001_20240710_1552_JOELLE			402/10
Types de prothèses		Informations			
		Client:		350186346	
		Contact:			
		Patient:		RAINERO JOELLE	
		Importance:		Normale	
		Date de création:		10/07/2024 15:52	
		Date d'expédition:		10/07/2024 15:52	
		Date de livraison:		12/07/2024 00:00	
		Date d'impression:		12/07/2024 10:09	
		Utilisateur:			
		Type d'objet:		Empreinte numérique	
		Photo clinique:		Oui	
		Poste / Technicien		Approuvé(e) par	
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant	
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only	
Commentaires					
GUIDE CHIR 25 26					

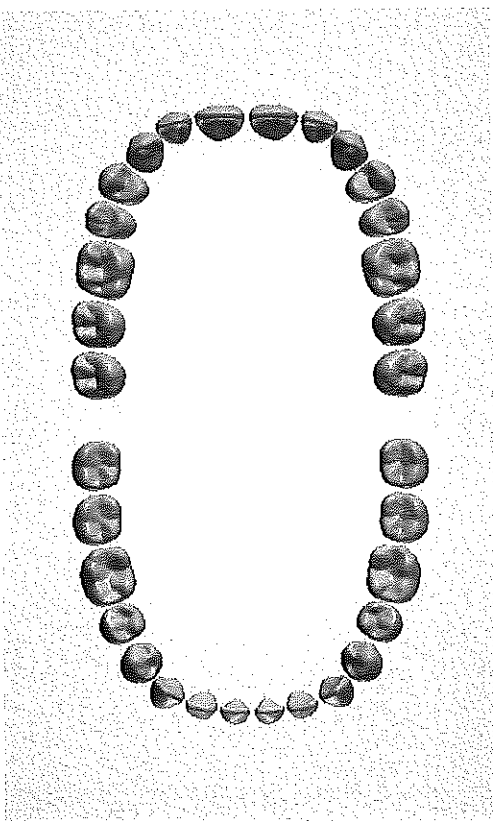

Rapport chirurgical

Détails de la commande

Nom du patient:

Joelle Rainero

Référence de commande client:

62721_20240712_1014_38

Date de création:


24/07/2024 15:57:22

Validé(e) par


Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)



VALIDÉ(E)


Maxillaire


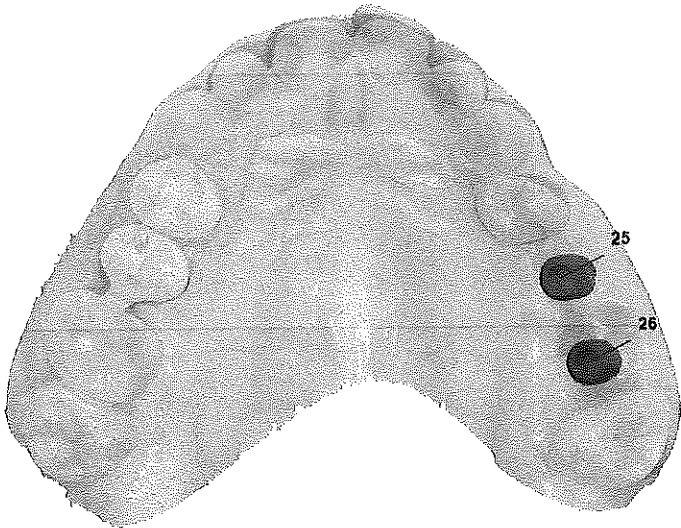


Informations sur l'implant		
Position de l'implant (FDI)	25	26
Fabricant	Global D	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L10.0 mm	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.5L10	DPINK4.5L8.5
Longueur, mm	10	8,5
Diamètre (Ø), mm	4,5	4,5
Couleur	Purple	Purple

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	25	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.5L10	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Purple	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

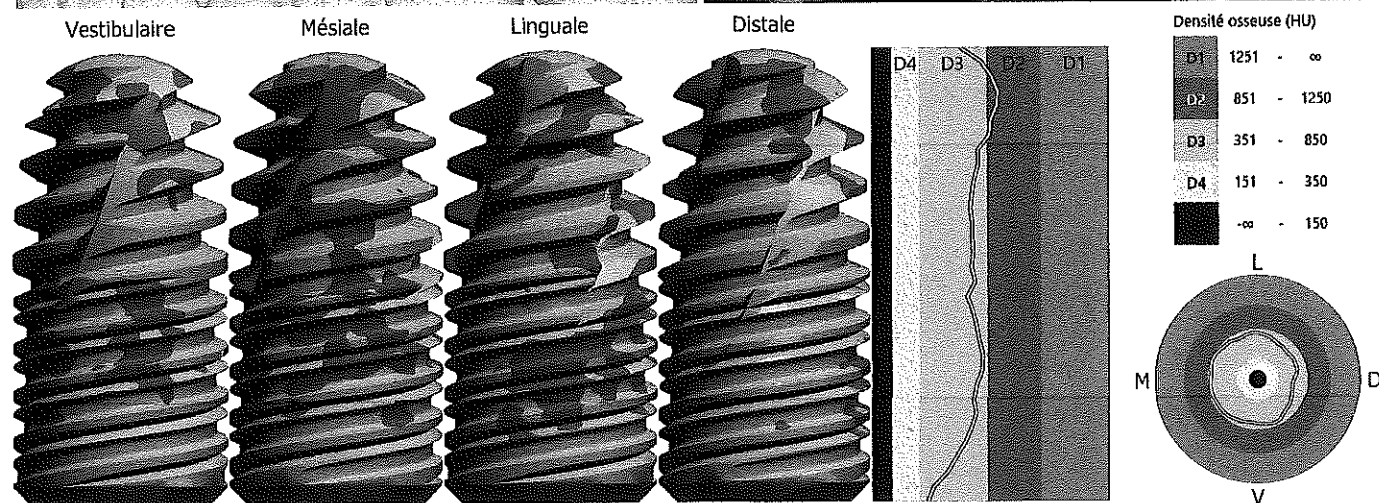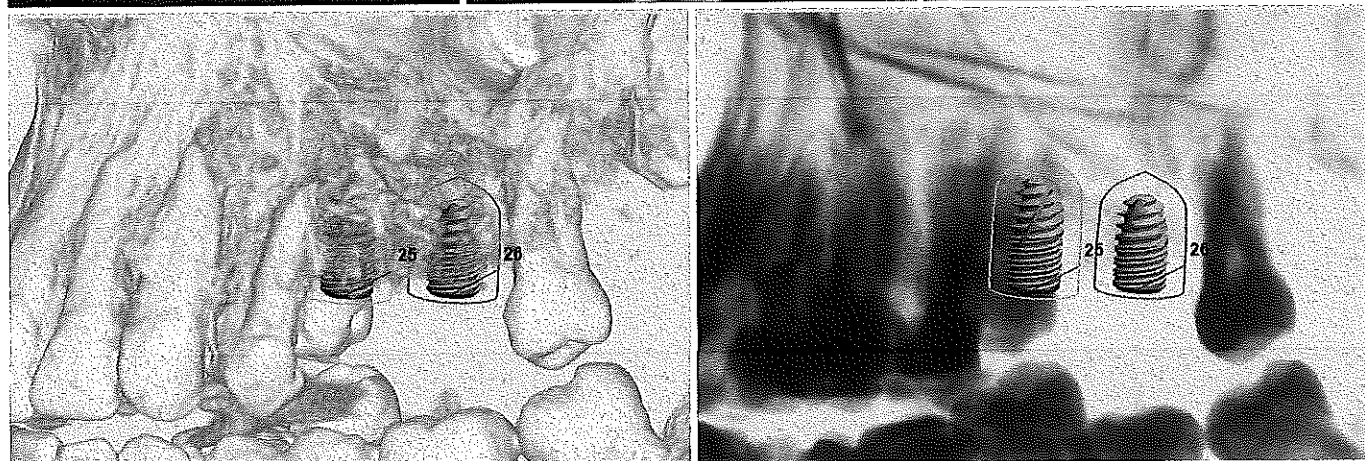

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	26	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Purple	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

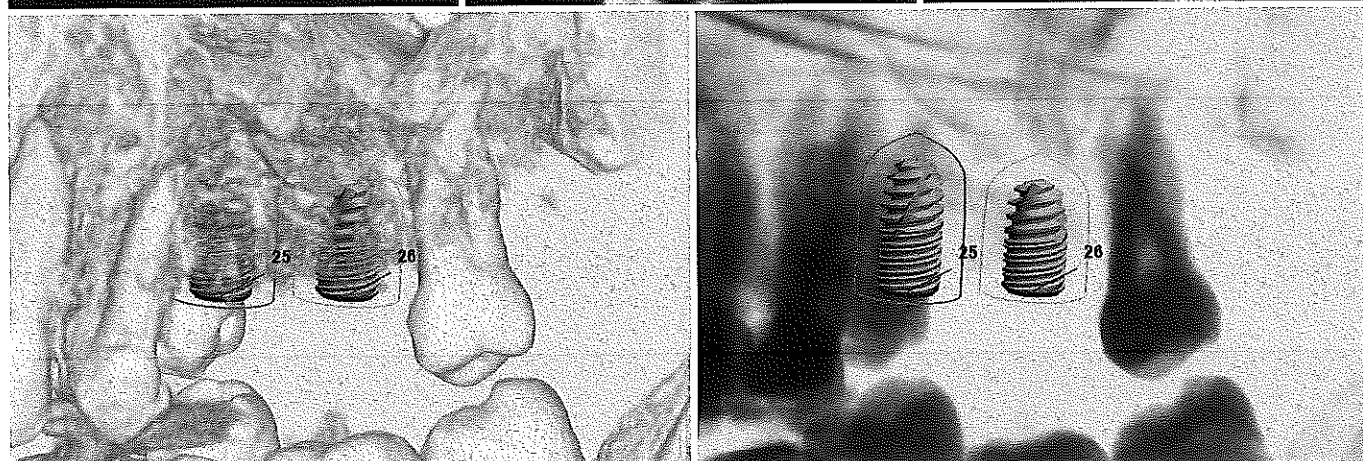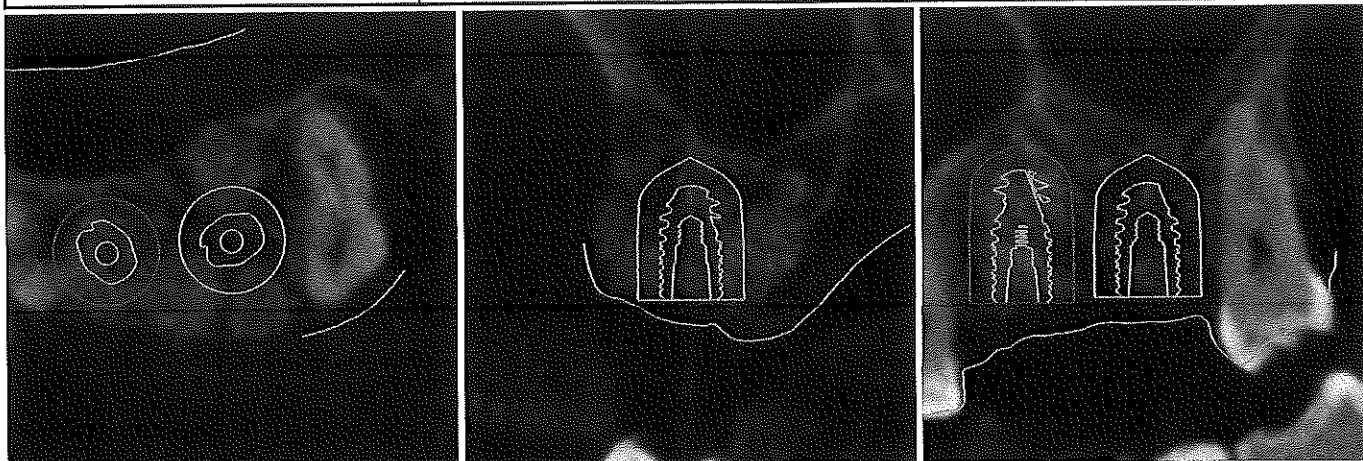


Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale

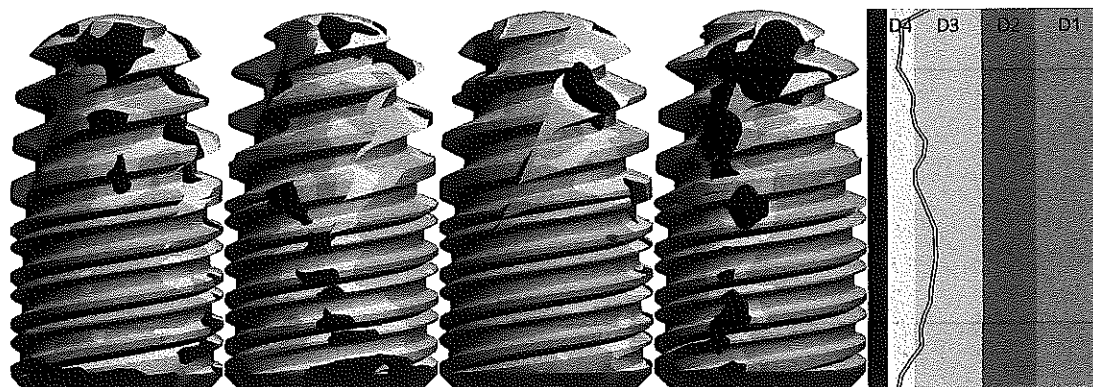

Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.