


3Shape Implant Studio
Rapport chirurgical



POUR
VALIDATION

Valide(e) par 


Détails de la commande

Nom du patient: Jeannine Verdier

Référence de commande 62721_20240912_0945_16

Date de création: 12/09/2024 10:03:56

Créé(e) par: Implant Studio Caplette -
implantstudio@caplette.fr
(05f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

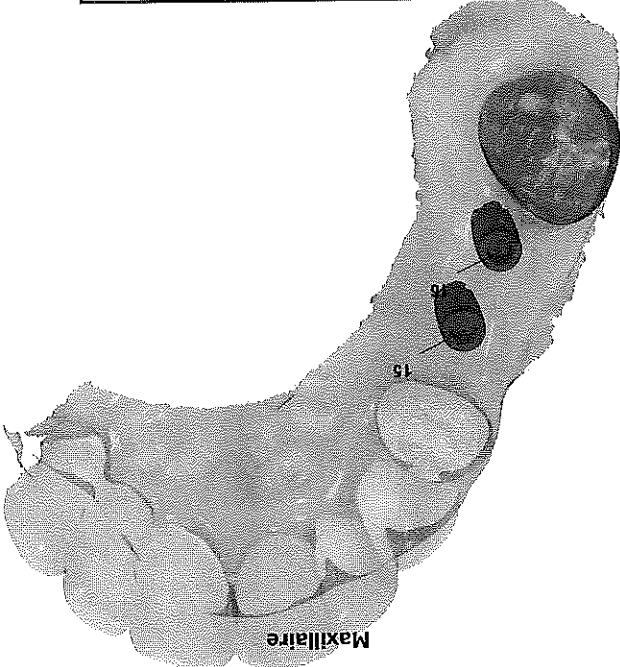


Informations sur l'implant			
Position de l'implant (FDI)	15	16	
Fabricant	TBR Dental	TBR Dental	
Type	M311	M311	
Numéro de la commande	M311	M311	
Longueur, mm	11,5	11,5	
Diamètre (Ø), mm	3,2	3,2	
Couleur	Pink	Pink	

Limitation de responsabilité : Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.













Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Limitation de responsabilité :

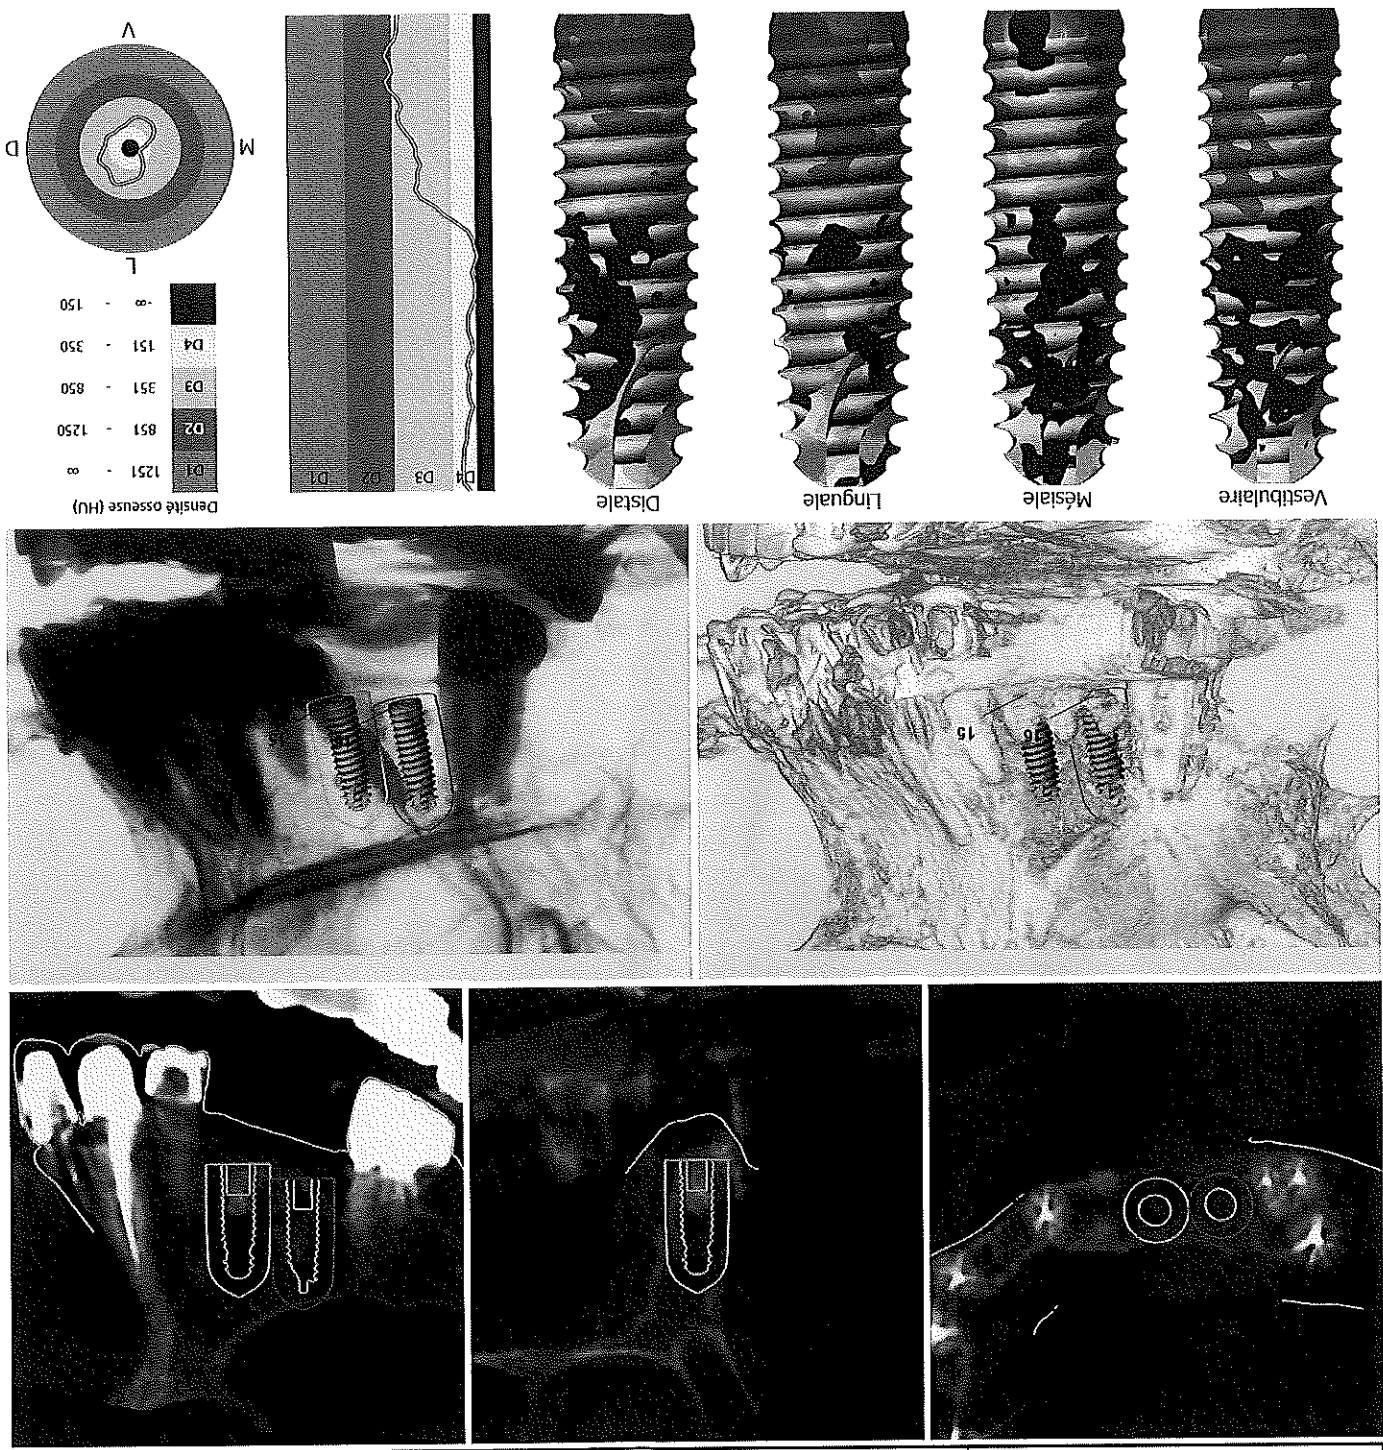

Implant Informations	
Position de l'implant (FDI)	15
Fabricant	TBR Dental
Type	M311
Numéro de la commande	M311
Longueur, mm	11,5
Diamètre (Ø), mm	3,2
Couleur	Pink
Zone de sécurité - distance apicale	2,0
Zone de sécurité - distance radiale	1,5

Implant Informations	
Position de l'implant (FDI)	16
Fabricant	TBR Dental
Type	M311
Numéro de la commande	M311
Longueur, mm	11,5
Diamètre (Ø), mm	3,2
Couleur	Pink
Zone de sécurité - distance apicale	2,0
Zone de sécurité - distance radiale	1,5

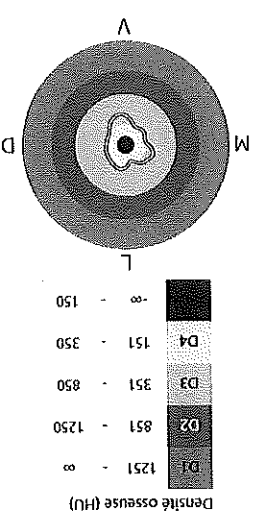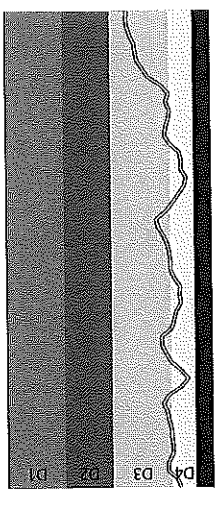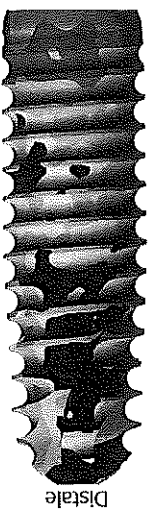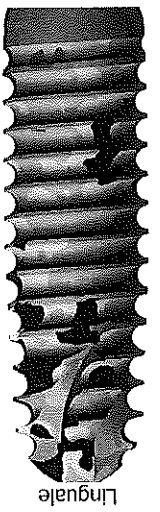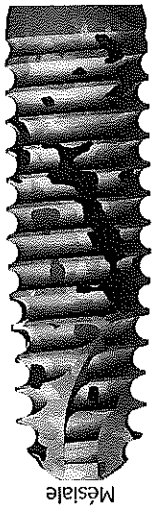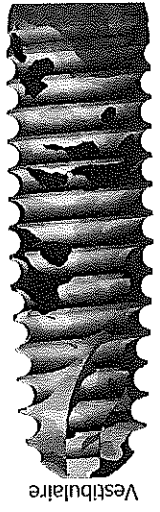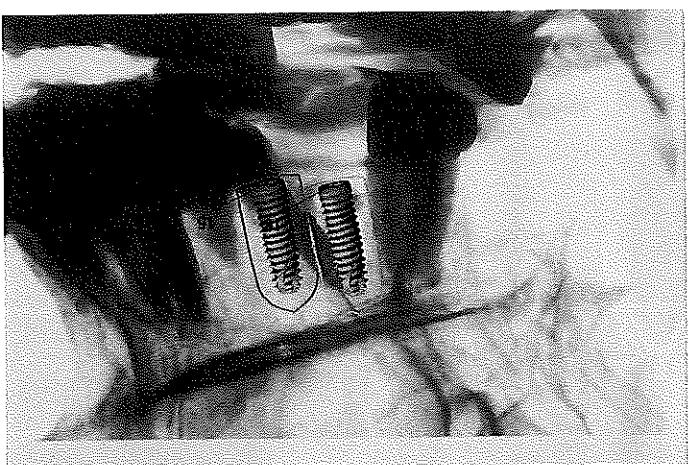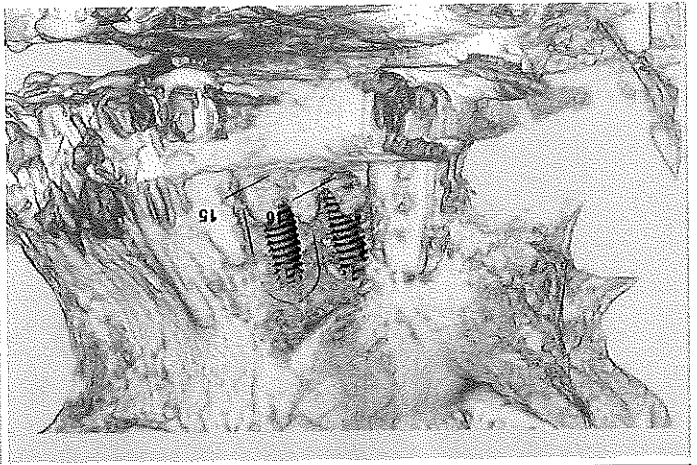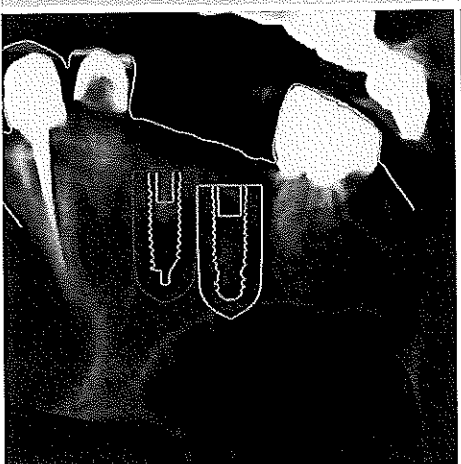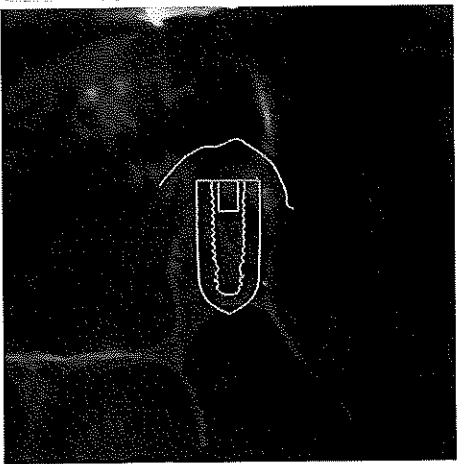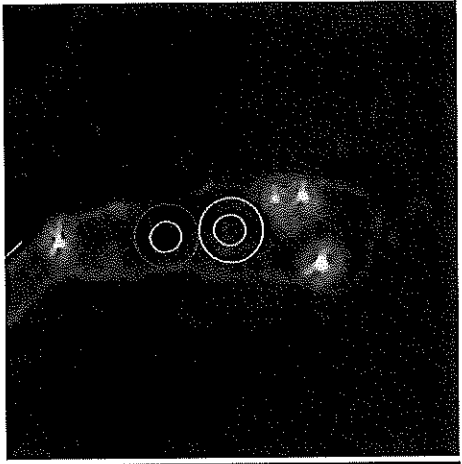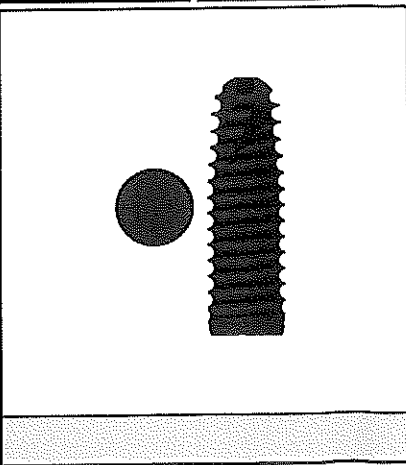

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.



VALIDÉ(E)

Détails de la commande


Nom du patient: Jeannine Verdier

Référence de commande 62721_20240912_0945_16

Client: 12/09/2024 10:03:56

Date de création:










Validé(e) par Implant Studio Capelette - implantsstudiocapelette@outlook.fr (0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

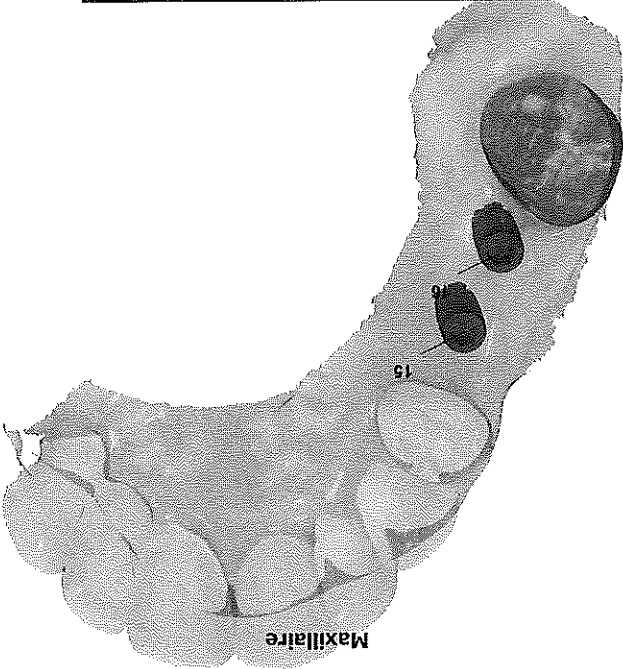

Informations sur l'implant			
Position de l'implant (FDI)	15		16
Fabricant	TBR Dental		TBR Dental
Type	M311		M311
Numéro de la commande	M311		M311
Longueur, mm	11,5		11,5
Diamètre (Ø), mm	3,2		3,2
Couleur	Pink		Pink








Limitation de responsabilité : Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	15	Fabricant
Type	M311	
Numéro de la commande	M311	
Longueur, mm	11,5	
Diamètre (Ø), mm	3,2	Couleur
		Pink
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

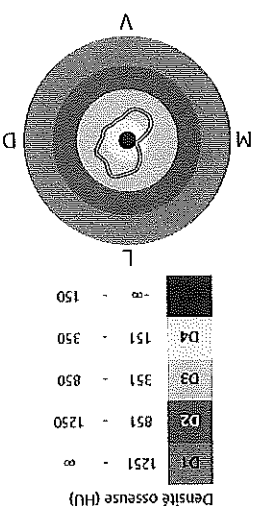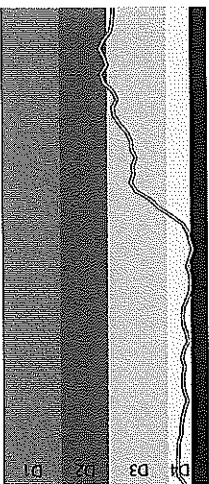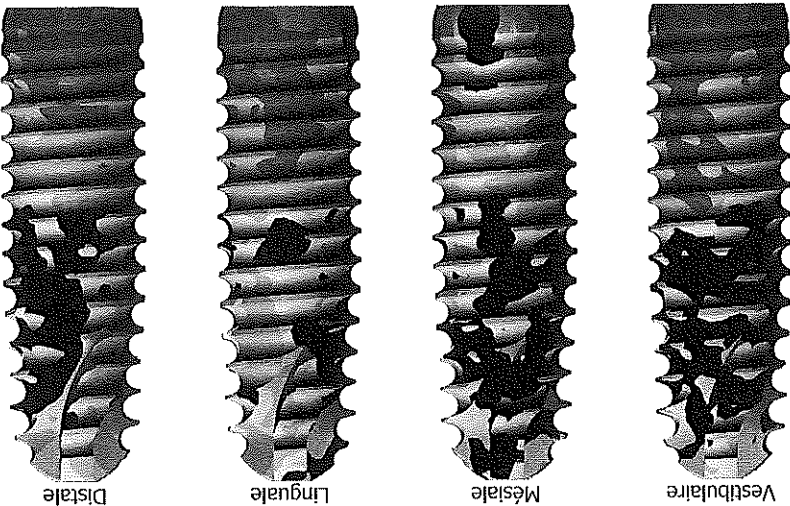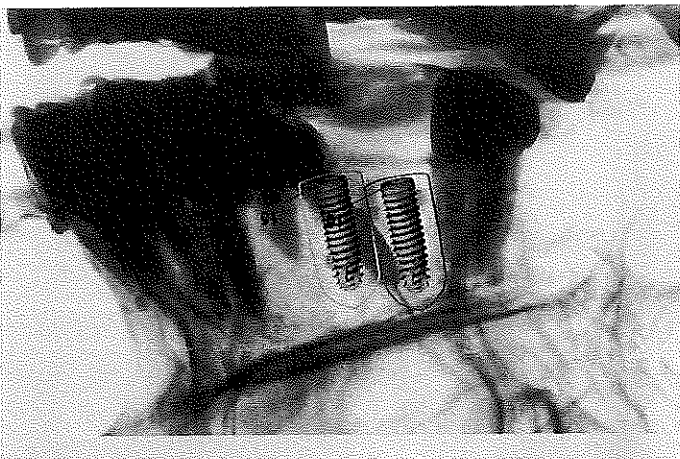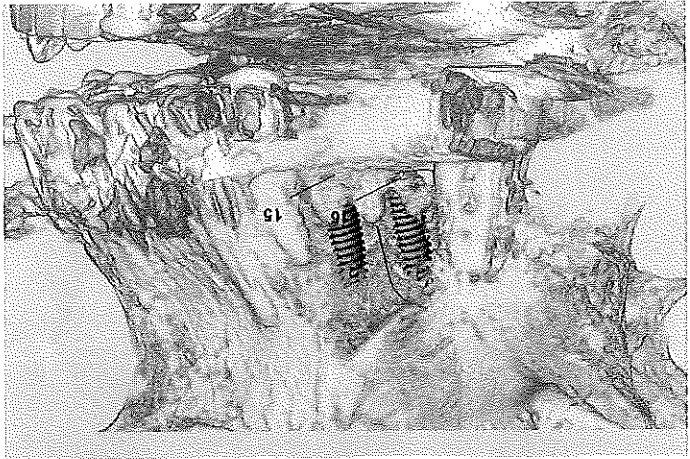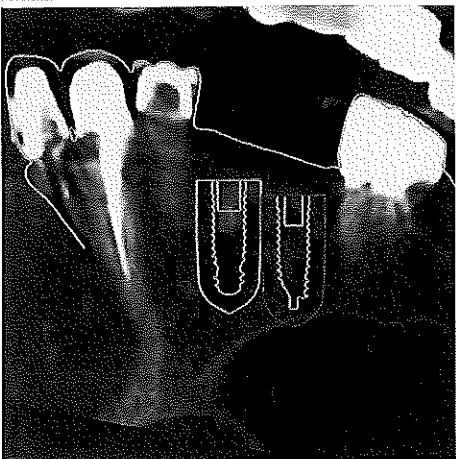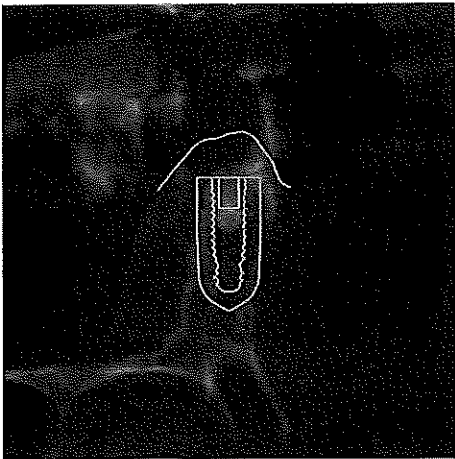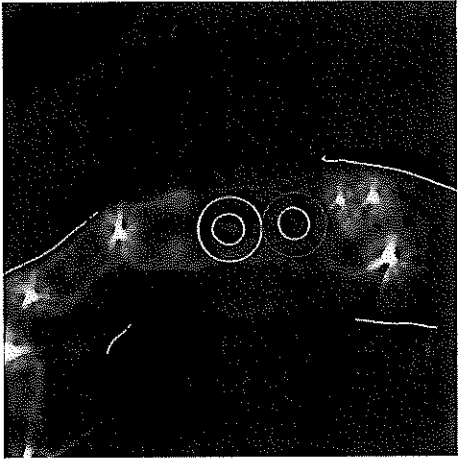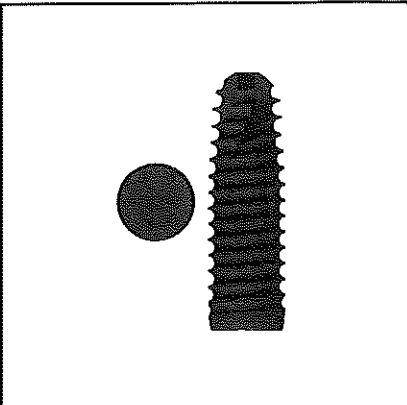

Limitation de responsabilité : Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations	
Position de l'implant (FDI)	16
Fabricant	TBR Dental
Type	M311
Numéro de la commande	M311
Longueur, mm	11,5
Diamètre (Ø), mm	3,2
Couleur	Pink
Zone de sécurité - distance apicale	2,0
Zone de sécurité - distance radiale	1,5

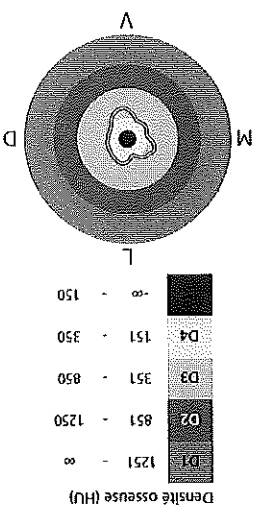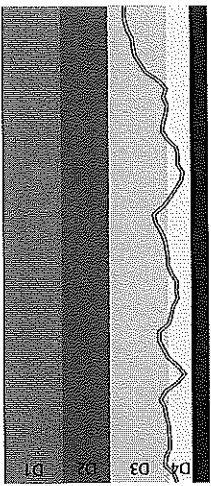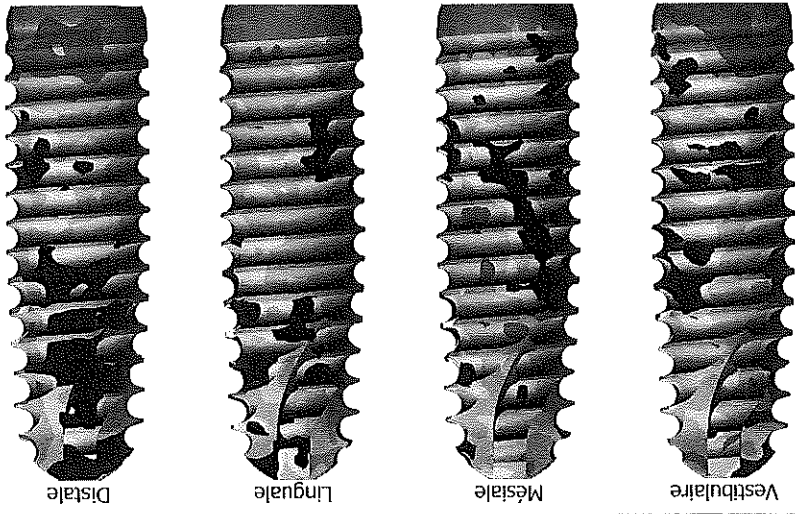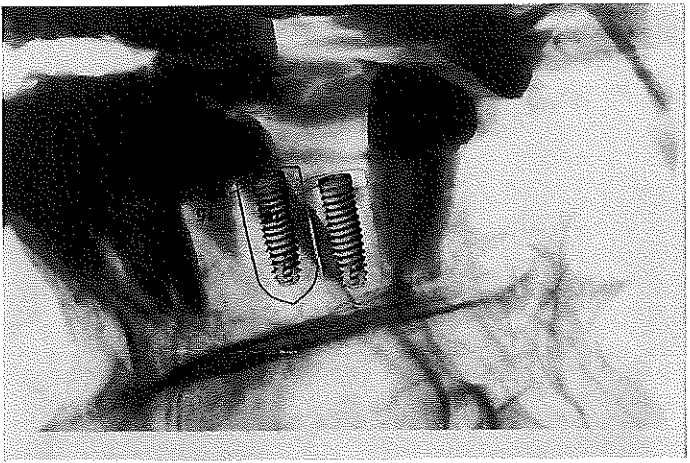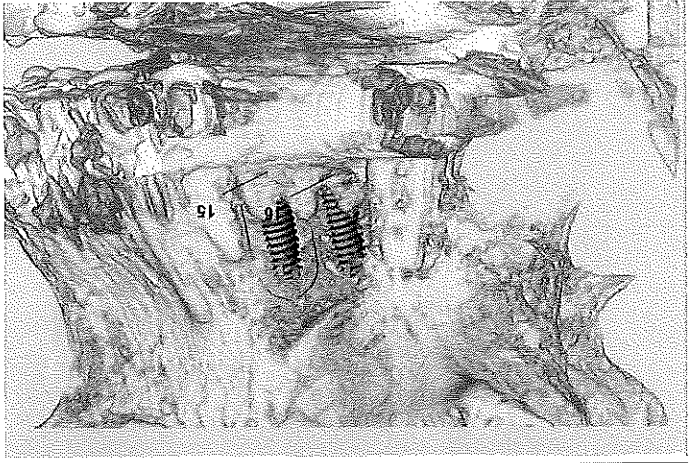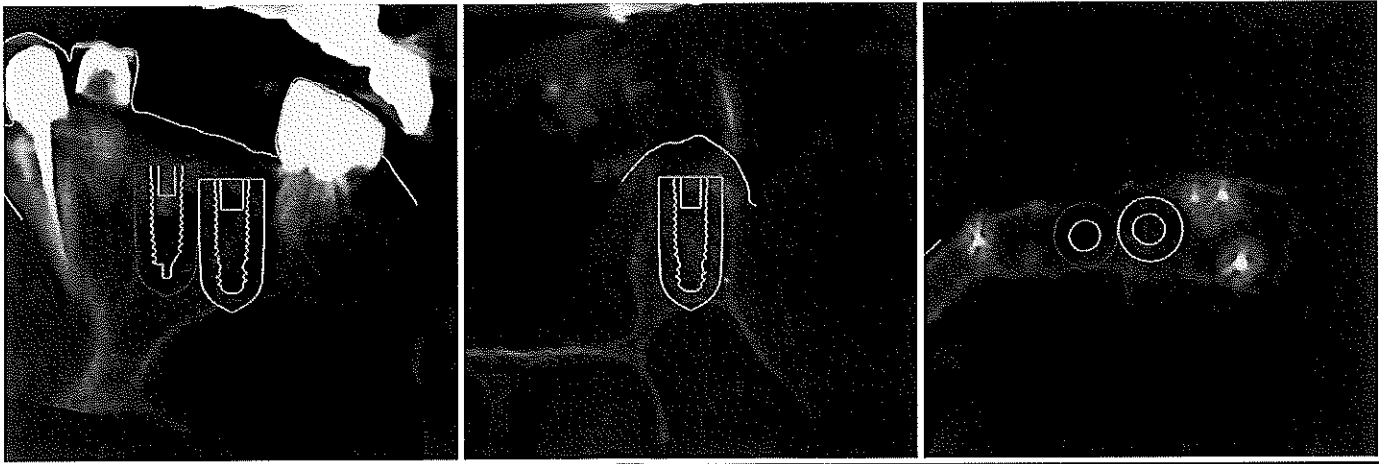

Limitation de responsabilité : Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnelisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.