

Coordonnées:

3Shape Implant Studio



Rapport chirurgical

Détails de la commande

Nom du patient:

Nacer Meziou

Référence de commande client:

62721_20241029_1033_30

Date de création:


29/10/2024 14:58:41

Validé(e) par

Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)








VALIDÉ(E)

Mandibule

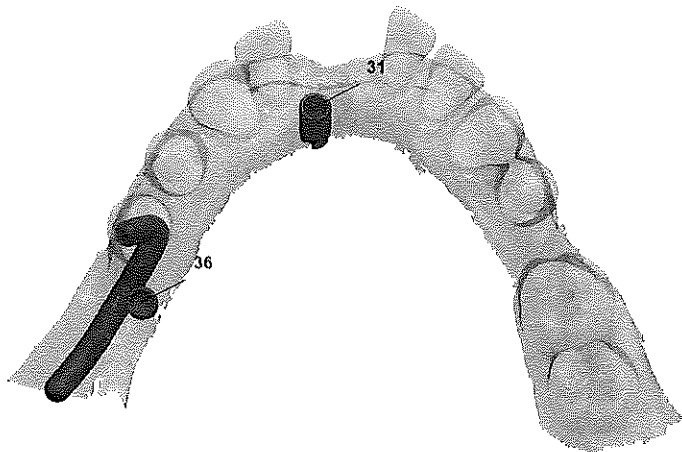

Informations sur l'implant			
Position de l'implant (FDI)	31		36
Fabricant	Global D		Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L10.0 mm		In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L10.0 mm
Numéro de la commande	DPINK3.5L10.0		DPINK3.5L10.0
Longueur, mm	10		10
Diamètre (Ø), mm	3,5		3,5
Couleur	Green		Green








Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	31	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK3.5L10.0	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	3,5	
Couleur	Green	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

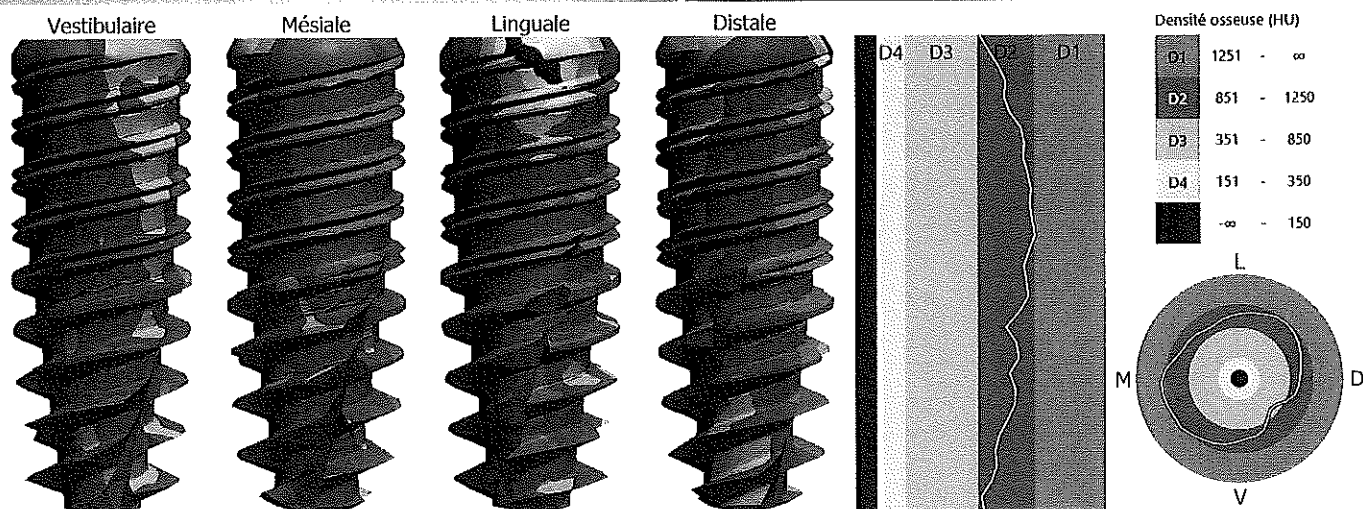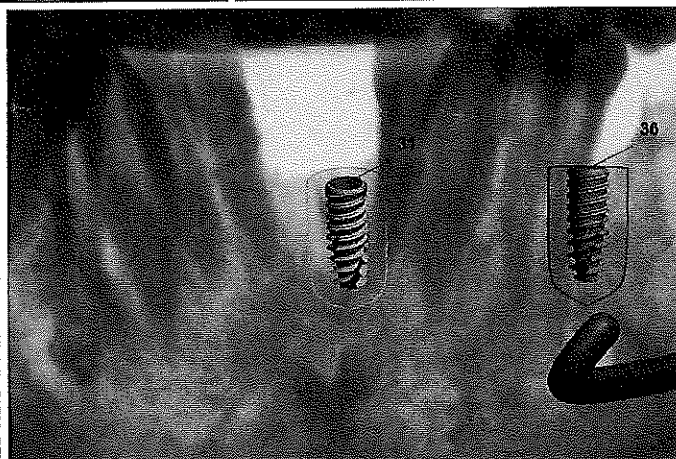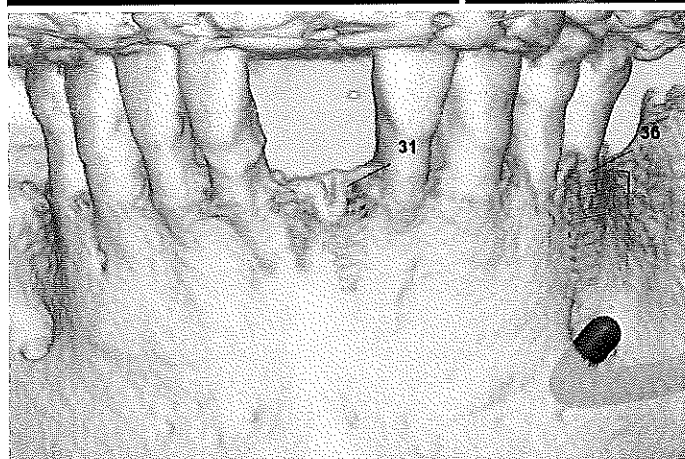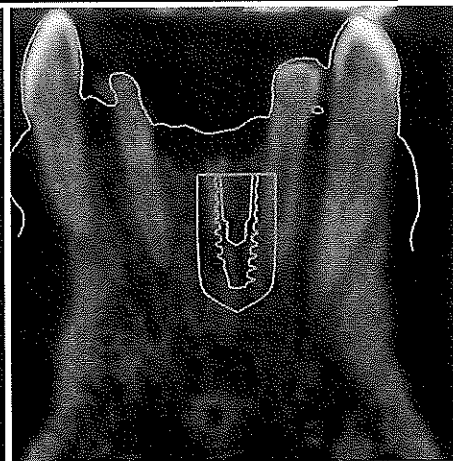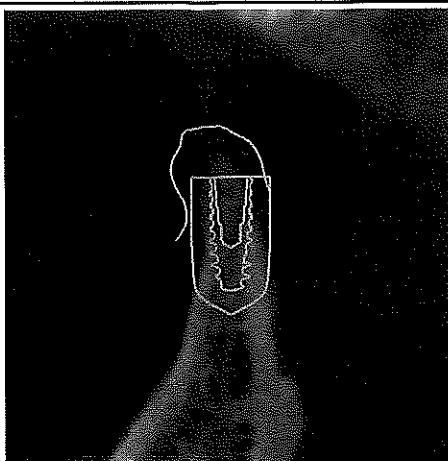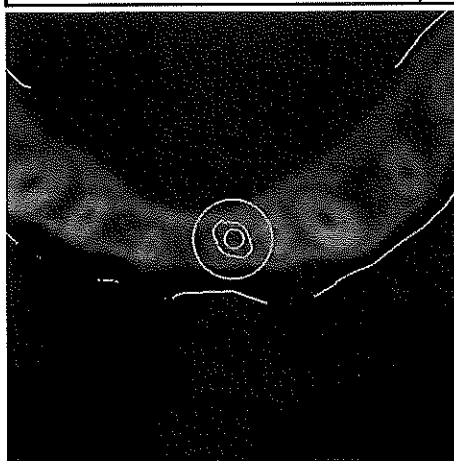

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	36	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK3.5L10.0	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	3,5	
Couleur	Green	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

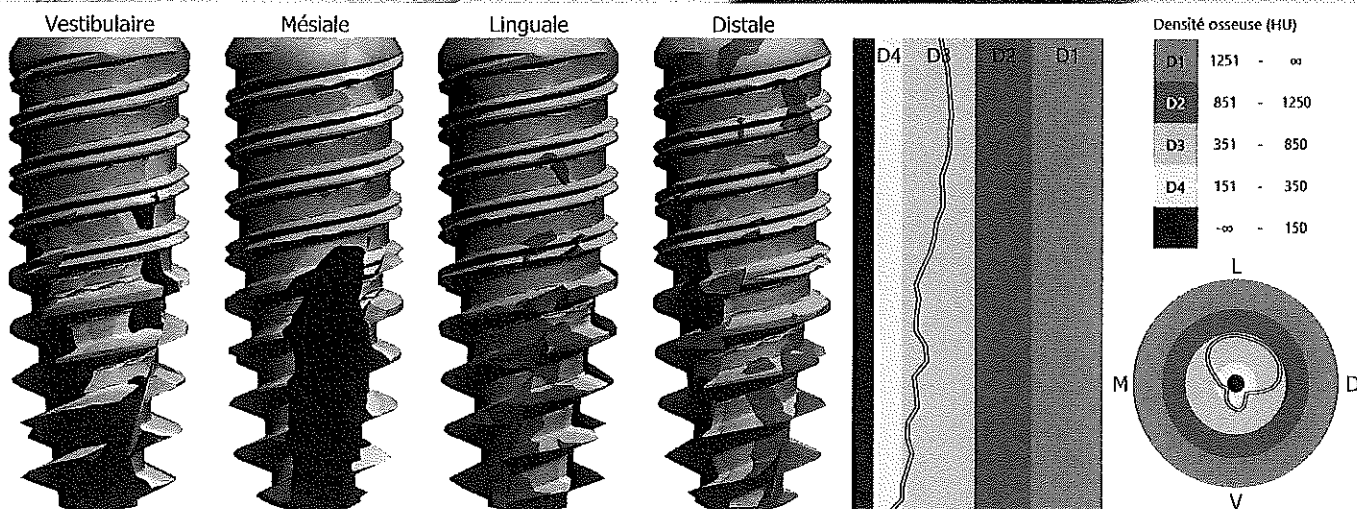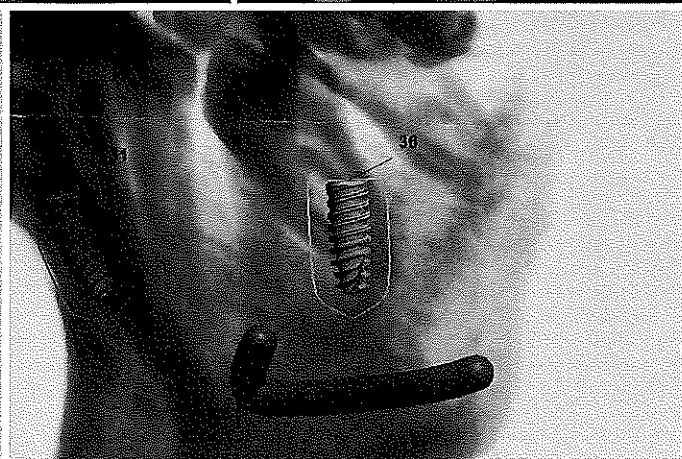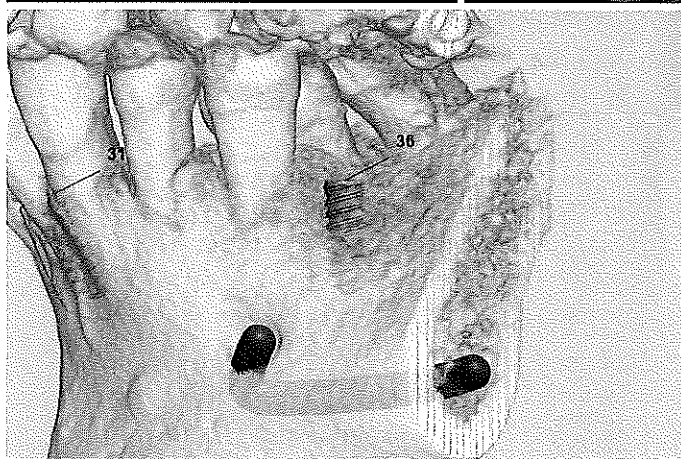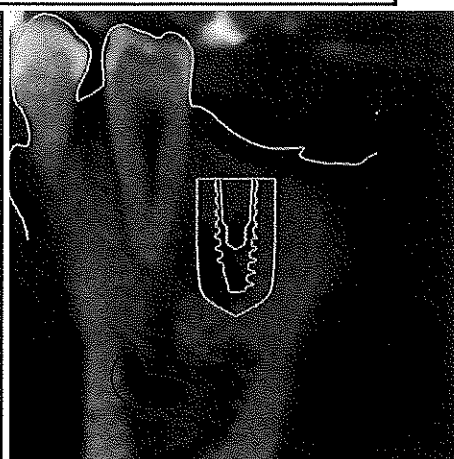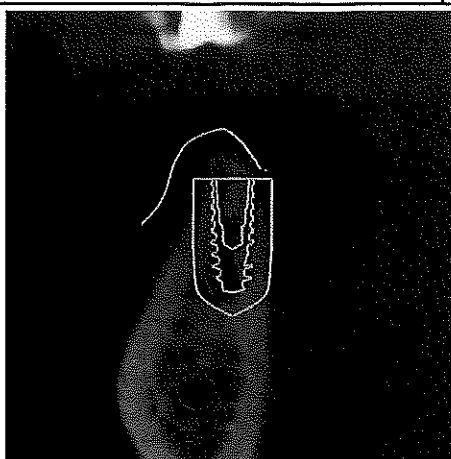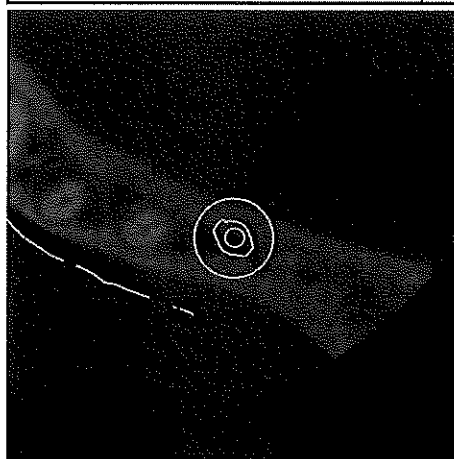

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.