



Rapport chirurgical

Détails de la commande

VALIDÉ(E)


Nom du patient: Christine Dancausse

Référence de commande client: 62721_20241002_1028_21

Date de création: 04/10/2024 14:50:29







Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Mandibule

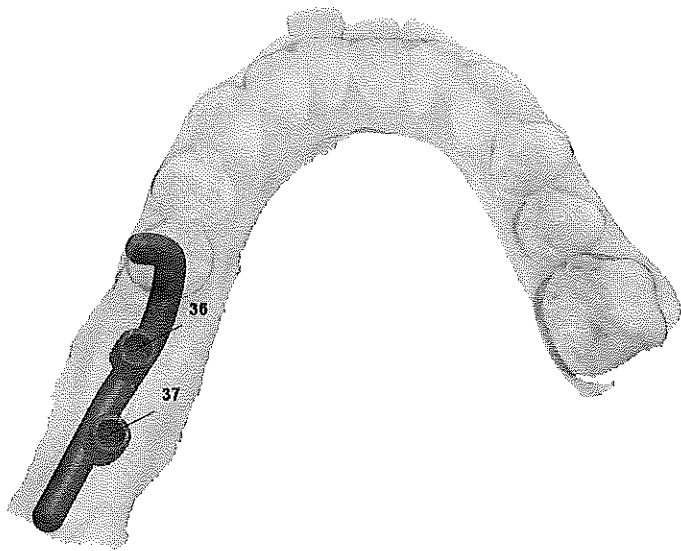

Informations sur l'implant			
Position de l'implant (FDI)	36		37
Fabricant	Global D		Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm		In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5		DPINK4.0L8.5
Longueur, mm	8,5		8,5
Diamètre (Ø), mm	4		4
Couleur	Yellow		Yellow

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	36	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

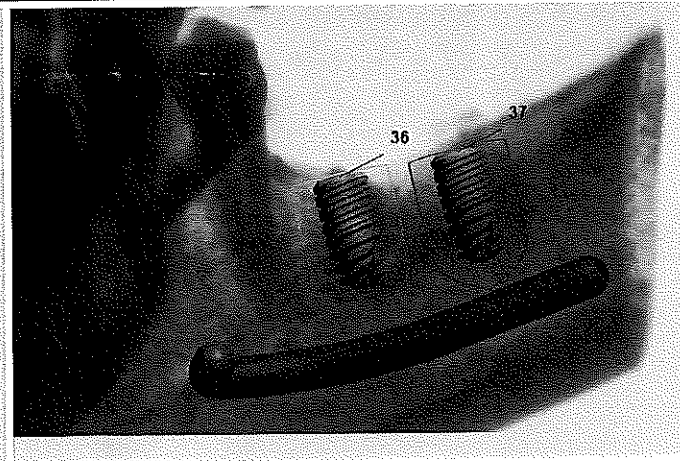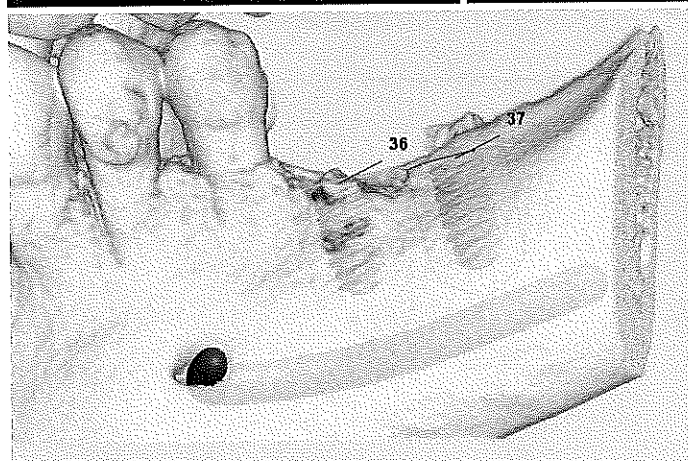
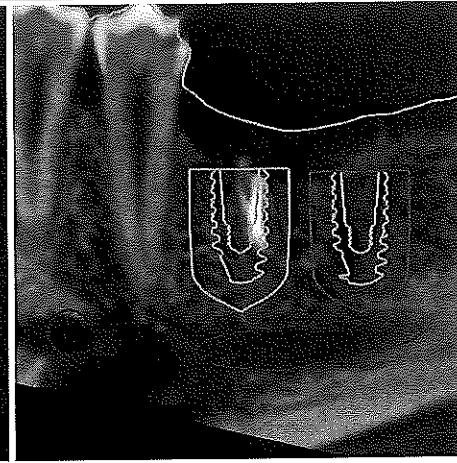
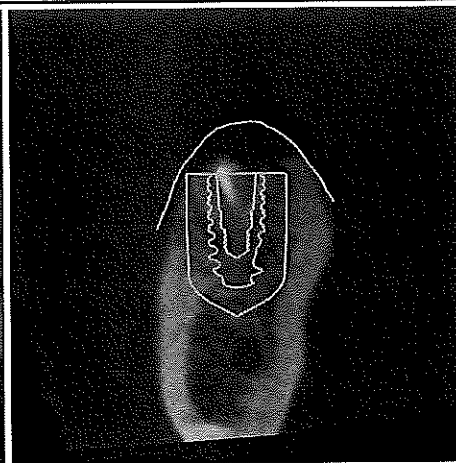
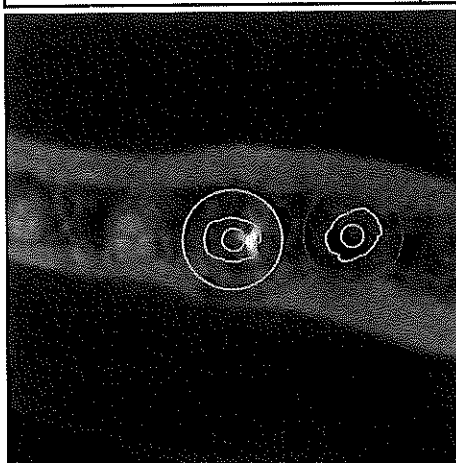



Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale

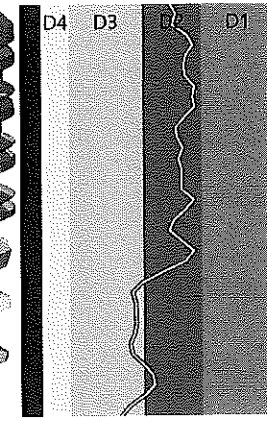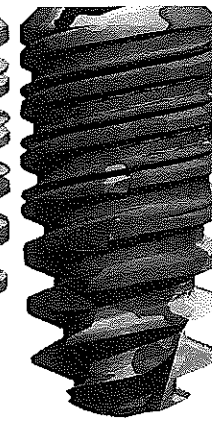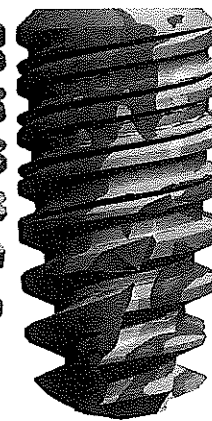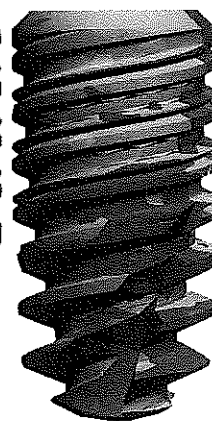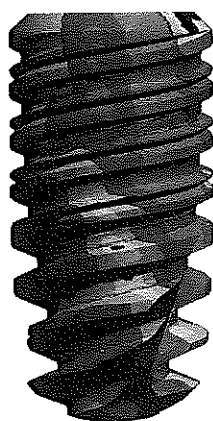

Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150









V

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	37	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

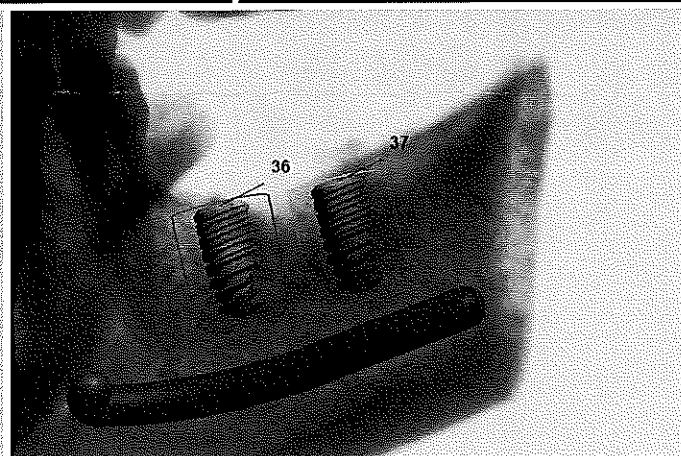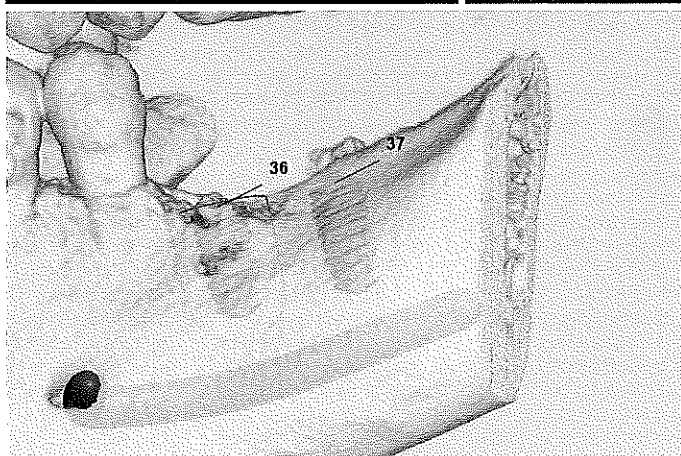
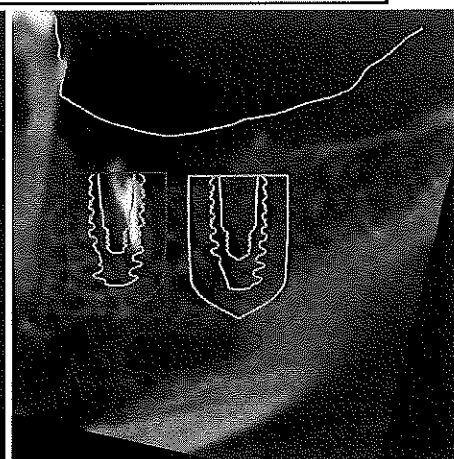
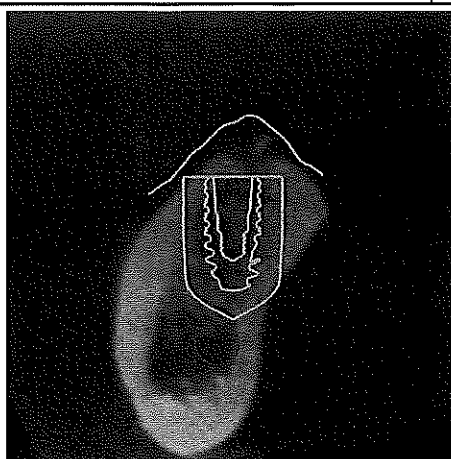
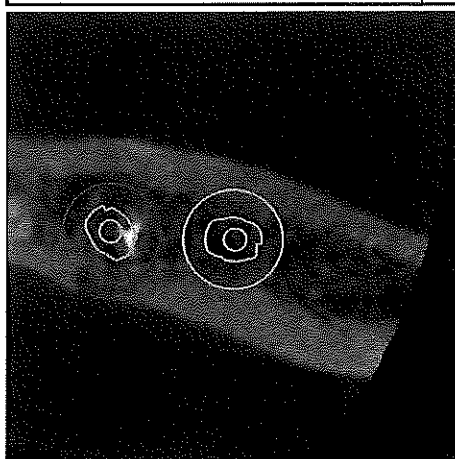



Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale

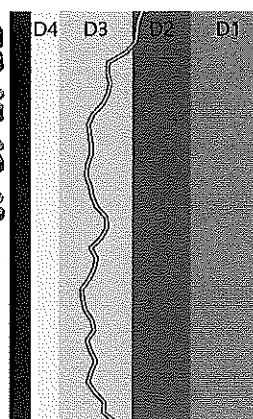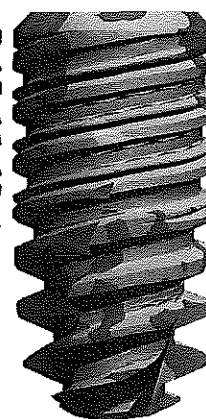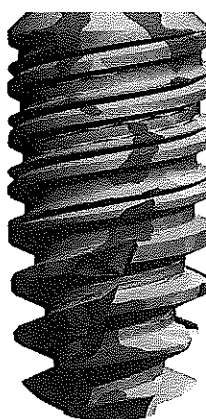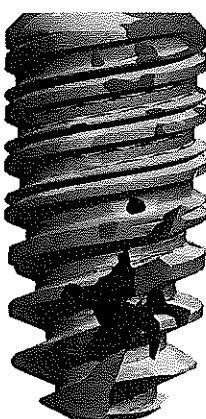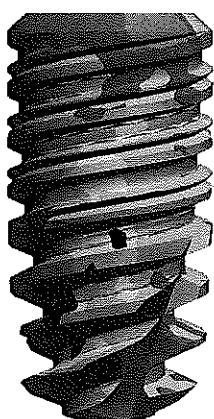

Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.