



Rapport chirurgical

Détails de la commande

VALIDÉ(E)


Nom du patient: Beatrice Rahault

Référence de commande client: 62721_20241105_1232_21

Date de création: 06/11/2024 10:54:23

Validé(e) par: Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Mandibule



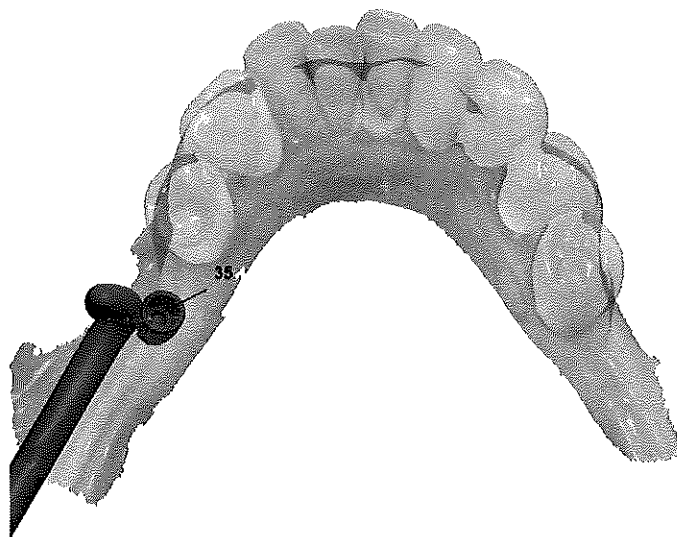


Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	35
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK3.5L8.5
Longueur, mm	8,5
Diamètre (Ø), mm	3,5
Couleur	Green


Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	35	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D3.5 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK3.5L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	3,5	
Couleur	Green	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

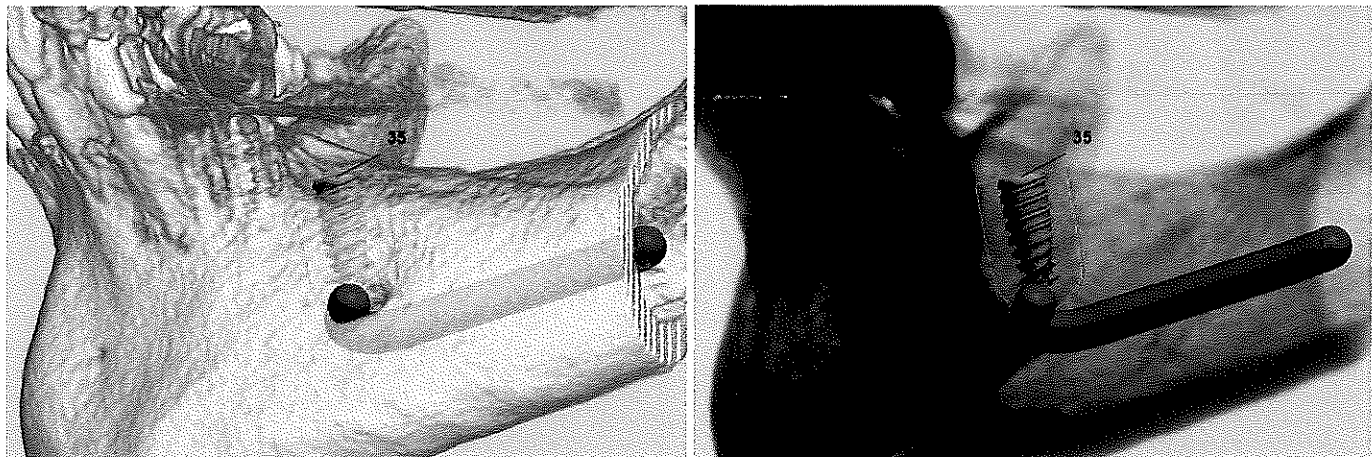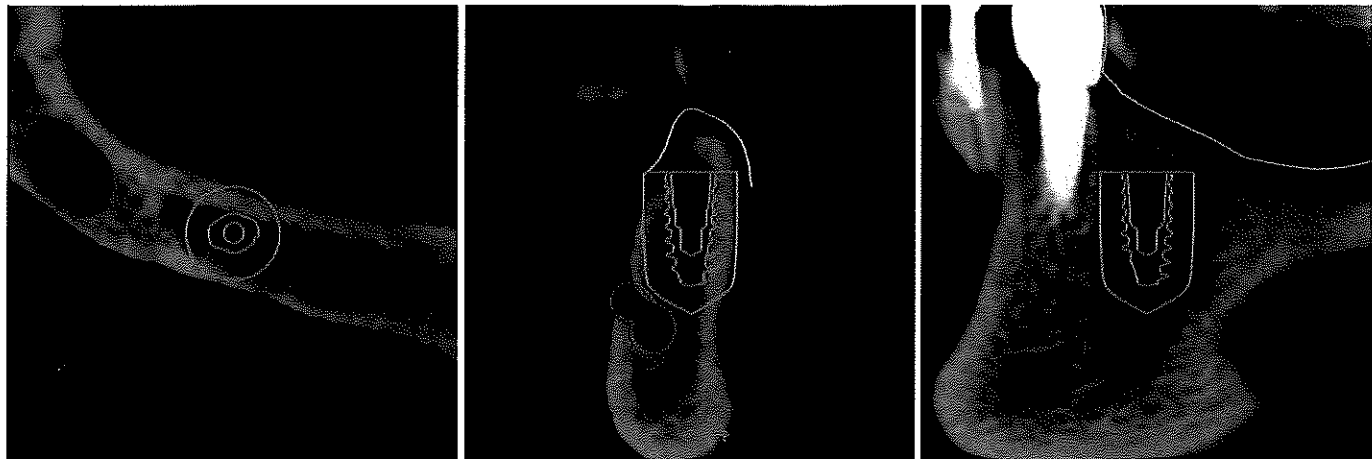

Vestibulaire Mésiale Linguale Distale

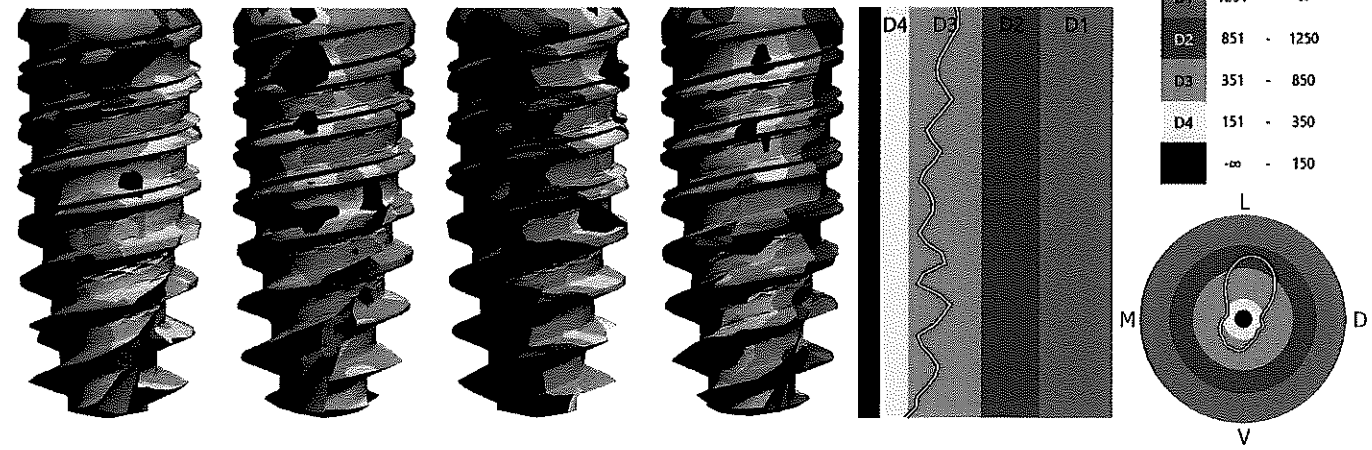

Limitation de responsabilité :
Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.