



Rapport chirurgical

Détails de la commande

VALIDÉ(E)

Nom du patient:

Benoit Soleil

Référence de commande client:

62721_20241128_1327_33


Date de création:

05/12/2024 12:50:51


Validé(e) par



Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Mandibule

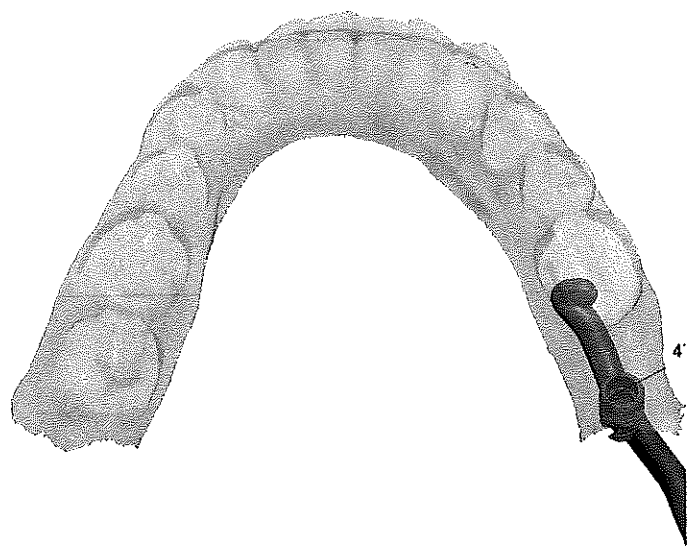

Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	47
Fabricant	Global D
Type	In-Kone Wide, Ø 4,5 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINKWD4.5L8.5
Longueur, mm	8,5
Diamètre (Ø), mm	4,5
Couleur	Violet

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	47	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone Wide, Ø 4.5 mm, L8,5 mm	
Numéro de la commande	DPINKWD4.5L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Violet	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	

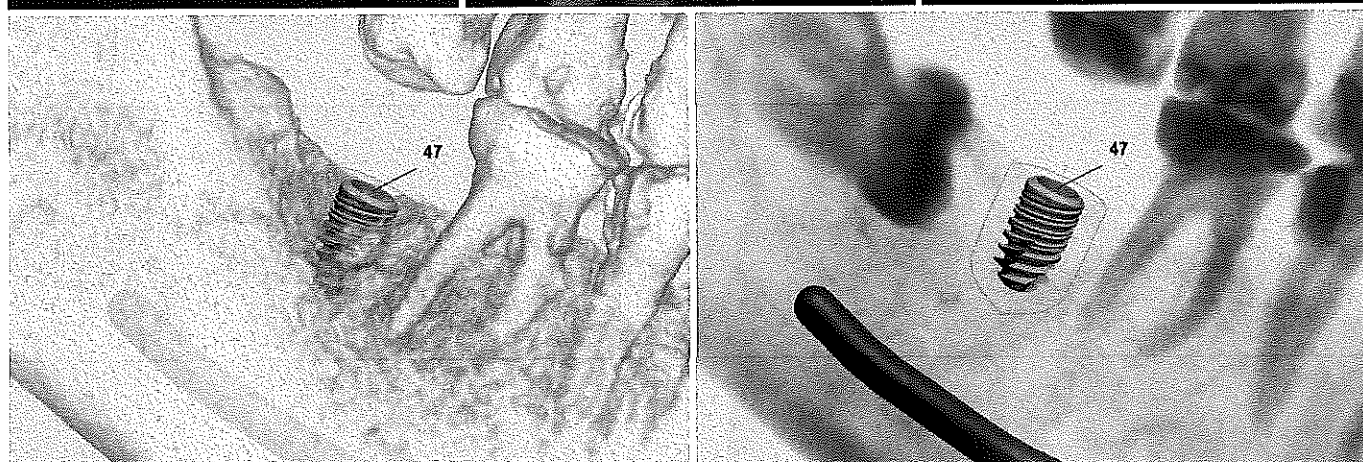
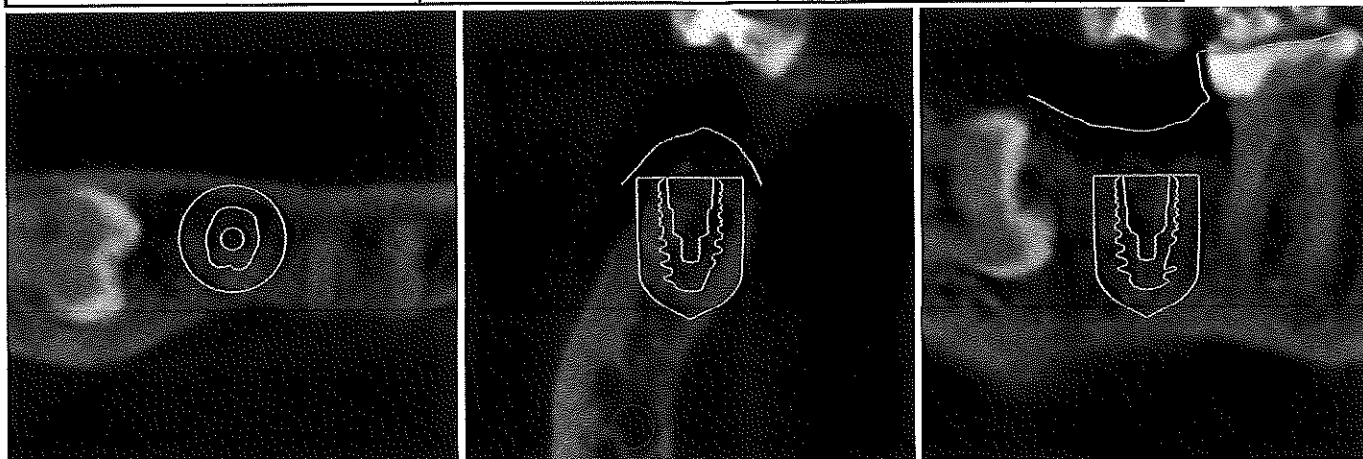


Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale

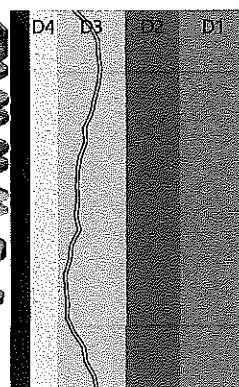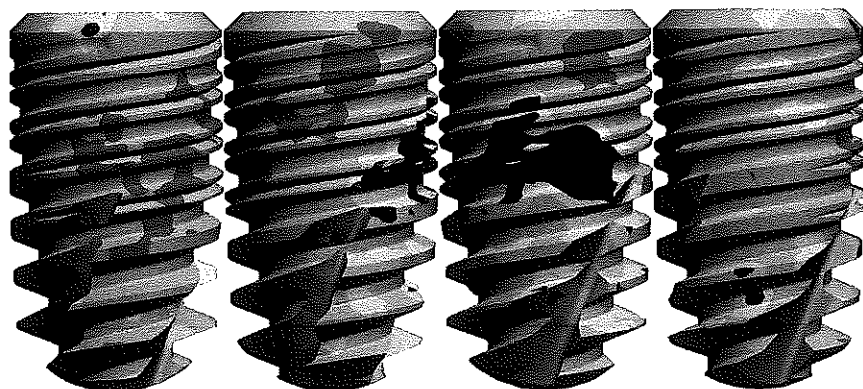

Densité osseuse (HU)

D1	1251	- ∞
D2	851	- 1250
D3	351	- 850
D4	151	- 350
	-∞	- 150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.